


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Byggherre Felles</b>  |  |  |  |
| <b>H Operasjon - NRH</b>                                       |  |  |  |
| Dato/tid:<br>29 nov 2023 8:30                                  | Lokasjon:<br>Forskningsparken  |  |  |
| Ansvarlig<br>Thomas Pryssing                                   |  | Klassifiseringskode  |  |
| Beskrivelse<br>Møte 3, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet |  | Neste møte i serien  |  |
| <b>Agenda</b>  |  |  |  |
| <b>001</b>   | <b>Agenda</b>  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte</li> <li>2. Hensikt og mål med møte</li> <li>3. Gjennomgang av funksjonsplan med status på innspill fra møte 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen</li> <li>- For rom som tidligere ikke er medvirket på (kvalitetssikring av romskisse, romfunksjonsprogram, utstyrsliste og spørsmål)</li> </ul> </li> <li>4. Verifisering av innspill til rom som har vært behandlet i tidligere medvirkningsmøter</li> <li>5. Oppsummering</li> <li>6. Veien videre</li> <li>7. Eventuelt</li> </ol> <p><i><a href="#">WFL-49323: Møte 03 pulje 1 - H Operasjon - NRH</a></i></p> |  |  |
| <b>002</b>   | <b>Velkommen – presentasjon av deltagere i møte</b>  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                       | <p>Se deltakerliste nedenfor.</p> <p><i><a href="#">Deltakere møte 3 H Operasjon NRH.xlsx</a></i></p>  |  |  |
| <b>003</b>   | <b>Hensikt og mål med møte</b>   |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                       | <p>Målet med møtet er å få avklart om utstyr i rommene er tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet, samt om utstyret er hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidsprosessene i rommet.</p>   |  |  |
| <b>004</b>   | <b>Gjennomgang av funksjonsplan etter møte 2</b>   |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                       | <p>Gjennomgang av sterilflyt pågår i samarbeid med fagkoordinator, gruppeleder og smittevern i OUS. Tilbakemeldinger fra denne prosessen inkluderes i neste møte med medvirkningsgruppen for operasjon.</p> <p>Plassering av rommen rundt sterilflyt gjennomgås i dette møtet i dag men drøftes også ifm supplerende møte i januar 2024.</p>   |  |  |

005



## Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen

Gruppen og fagkoordinator bekrefter at alle innspill er koordinert med NSA. Medvirkningsgruppen gikk gjennom sine spørsmål og innspill i plenum. Aksjoner for hvert rom er gitt i punkter nedenfor.

Gruppen oversender utstyrsinnspill til aktuelle rom i Excel-listen

Følgende aksjoner er felles for alle operasjonsstuer:

- Plassering av skjermer i 100 cfu-stuer: skjermene bør plasseres slik at de kan benyttes over hele bordet og i begge ender. Takfestene bør sentraliseres mer over operasjonsbordet.
- Varmeskapene kan være små med 2 hyller og plasseres i arbeidshøyde.
- Telefon: Nye OUS ønsker samme løsning som for RAD.
- Alarm/Tilkalling av internt HLR-team bør plasseres tett på anestesi
- Kamera i operasjonslampe: det er ønskelig med kamera i en lampe per operasjonsstue
- Alle operasjonsmikroskop skal være mobile

[Innsendt utstyrsliste hybridstuer NRH.xlsx](#)

[Innsendt utstyrsliste Operasjon NRH.xlsx](#)

[2023 12 08 Innspill på plassering i rom.potx](#)

01 des 2023 **Anita Sofie Fenne frist: 06 des 2023**

**Kjøleskap til oppbevaring av organ**

Kjøleskap til oppbevaring av organer spesifiseres av gruppen

08 des 2023

*Det er behov for et kjøleskap i preparatrommet og legemiddelnisje. Ikke kjøleskap i operasjonsstuemalene. Det er behov for ultrafryser i hver etasje (eks. benbank) - gjerne nær PNA-nisjer. (Anita Sofie Fenne)*

01 des 2023 **Stine Johannessen frist: 15 des 2023**

**Operasjonsmikroskop**

Alle operasjonsmikroskop skal være mobile

01 des 2023 **Stine Johannessen frist: 15 des 2023**

**Kamera i operasjonslampe**

Det er ønskelig med kamera i en lampe per operasjonsstue

01 des 2023 **Marte Loen frist: 15 des 2023**

**Tilkalling av internt HLR-team**

Enhet for tilkalling bør plasseres tett på anestesi

01 des 2023 **Thomas Pryssing frist: 15 des 2023**

**Telefon**

Nye OUS ønsker samme løsning som for RAD. HSØ PO undersøker internt hvilken løsning som er lagt til grunn

01 des 2023 **Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023**

**Varmeskap**

Gruppen gir tilbakemelding på plassering av varmeskap per mal i operasjonsstuen

08 des 2023

*Varmeskap på veggen mot korridor. Lett tilgang for både operasjon og anestesi. Ikke i konflikt med pasientseng som skal trilles inn. Se Powerpoint side 4.*

*(Anita Sofie Fenne)*

01 des 2023 **Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023**  
**Lystgass- og diatermibruk på operasjonsstuer**

Gruppen spesifiserer behov per mal for operasjonsstuene.

08 des 2023

*Behovet for lystgass er spilt inn fra OUS i notat av 18 02 2022 "Behov for lystgass og avsug for narkosegasser i nye sykehusbygg". Operasjonsstuene på Rikshospitalet bestykses med lystgass som beskrevet i notatet. Se vedlegg. Det er behov for punktavsug på alle operasjonsstuene for fleksibel drift. Plasseres over fotenden/nedre del av pasienten. (Anita Sofie Fenne)*

01 des 2023 **Marte Loen frist: 15 des 2023**

**Plassering av skjermer i 100 cfu-operasjonsstuer**

Skjermene bør plasseres slik at de kan benyttes over hele bordet og i begge ender. Takfestene bør sentraliseres mer over operasjonsbordet. Innspillet gjelder alle 100 cfu-operasjonsstuer. Arkitekt oppdaterer skissene i samarbeid med rådgiver utstyr

01 des 2023 **Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023**

**Gruppens innspill til utstyrlister**

Gruppen oversender utstyrsinnspill til aktuelle rom oppgitt i Excel-listen

04 des 2023

*Se vedlagte lister. (Anita Sofie Fenne)*

006

**Mal for Operasjon, endoskopi 08.01.015 (100 cfu)**



Gruppene synes at romutforming for malen er tilfredsstillende, men det er behov for mer veggplass for oppbevaring av ulikt utstyr. Det bør vurderes om vinduene kan gjøre mindre eller om det kun skal være ett vindu. Endoskopistuerne bør kunne mørklegges, og vindusflatene bør ikke være for store.

Gjennomstikkskap for prosedyrevogner beholdes som et åpent areal, for høyere fleksibilitet. Alle gjennomstikksskapene skal være gjennomgående. Arkitekt kvalitetssikrer skissene.

Kjøleskap kalde væsker og frys for is: gruppen gir tilbakemelding på ønsket plassering i rom

01 des 2023 **Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023**

**Kjøle- og fryseskap**

Kjøleskap kalde væsker og frys for is: gruppen gir tilbakemelding på ønsket plassering i rom

08 des 2023

*Fryseskap i preparatrom. Kjøleskap plasseres som nevnt i forrige aksjonspunkt. (Anita Sofie Fenne)*

01 des 2023 **Marte Loen frist: 15 des 2023**

**Dør til gjennomstikkskap for prosedyrevogner**

Alle gjennomstikksskap skal være gjennomgående. Arkitekt kvalitetssikrer at alle rom har dører både til korridor og operasjonsstue.

01 des 2023 **Marte Loen frist: 15 des 2023**

**Vinduer i operasjonsstuene**

Det er behov for mer veggplass for oppbevaring av ulikt utstyr. Prosjekteringsgruppen vurderer om vinduene kan gjøre mindre eller om det kun skal være ett vindu. Endoskopistuerne bør kunne mørklegges, og vindusflatene bør ikke være for store.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>007</b></p> <input type="checkbox"/> | <p><b>Mal for Operasjon, robot 08.01.016 (100 cfu)</b></p> <p>Det finnes ulike løsninger for utstyrsroboter og styringsenheter. Styringsenhetene kan plasseres mot hverandre på vindusvegg. Skap kassebakke skal være mobile.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Plassering av utstyr</b></p> <p><u>Styringsenhetene kan plasseres mot hverandre på vindusvegg. Skap kassebakke skal være mobile.</u></p>  |
| <p><b>008</b></p> <input type="checkbox"/> | <p><b>Mal for Operasjon, urologi 08.01.018 (100 cfu)</b></p> <p>Anestesiapp skal stå på høyre side av pasienten, og passasje ved anesthesiapparat sjekkes</p> <p>Plassering av varmeskap er ok. PC må flyttes flyttes nærmere varmeskap (gjelder alle operasjonsstuer).</p> <p><u>04 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Plassering av utstyr</b></p> <p><u>Anestesiapp skal stå på høyre side av pasienten, og passasje ved anesthesiapparat sjekkes</u></p> <p><u>Plassering av varmeskap er ok. PC må flyttes flyttes nærmere varmeskap (gjelder alle operasjonsstuer).</u></p>   |
| <p><b>009</b></p> <input type="checkbox"/> | <p><b>Mal for Operasjon, sectio 08.01.019 (100 cfu)</b></p> <p>Plassering av varmeskap er tilfredsstillende.</p> <p><u>04 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Justering av skisse (samt tekst på skisse)</b></p> <p><u>Tekst tilhørende gjennomstikksskap i skissen er feil. Arkitekten retter skissen.</u></p>  |
| <p><b>010</b></p> <input type="checkbox"/> | <p><b>Mal for Operasjon, implantat 08.01.007 (10 cfu)</b></p> <p>Alle takfester for utstyr må plasseres utenfor LAF-tak. Smittevern har svart ut ønsket størrelse på 10 cfu-felt.</p> <p>Gruppen ønsker at varmeskap flyttes nærmere skaprekken, og mulighet for å koble MTU til strøm i nærheten av rommets hjørner.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Plassering av utstyr og tilkobling til strøm</b></p> <p><u>Gruppen ønsker at varmeskap flyttes nærmere skaprekken, og mulighet for å koble MTU til strøm i nærhet til rommets hjørner.</u></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Stine Johannessen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Kurs for c-bue på operasjonsstuer</b></p> <p><u>Det må avklares om det skal være egen kurs for c-buer. Rådgiver utstyr koordinerer med rådgiver elektro.</u></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023</b></p> <p><b>G-bue</b></p> <p><u>Gruppen avklarer plassering og antall G-buer</u></p> <p>04 des 2023</p> <p><u>1 stk G-bue er plassert i utstyrlager (Anita Sofie Fenne)</u></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>011</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>08.01.047/048 Desinfeksjon</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.047 og 08.01.048 Desinfeksjon, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p>Kjemikalieskap skal benyttes for vaskemidler til maskinene, og det er ikke har behov for ventilering. Gruppen antyder 6 x 5L-dunker med vaskemidler. Krav for oppbevaringsmende må undersøkes.</p> <p>Punktavsug burde være stort og fleksibelt nok til å benyttes både kum og benk pga damp fra kjemikalier. Kum bør være minst 1 m bred i tillegg til 1 m benk. Rengjøringspistol skal være todelt, må ha både luft og vann.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Punktavsug og benk</b><br/> <u>Punktavsug burde være stort og fleksibelt nok til å benyttes både kum og benk pga damp fra kjemikalier. Kum bør være minst 1 m bred i tillegg til 1 m benk.</u></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Stine Johannessen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Kjemikalieskap</b><br/> <u>Kjemikalieskap skal benyttes for vaskemidler til maskinene. Gruppen antyder 6 x 5L-dunker med vaskemidler. Krav for oppbevaringsmengde må undersøkes. Rådgiver utstyr og vvs undersöker krav til avtrekk.</u></p>   |
| <p><b>012</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>08.01.183/184 Laboratorium, preparatrom</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.183 og 08.01.084 Laboratorium, preparatrom, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p>Rørpost flyttes ut av rommet med tilgang fra korridor, og flyten i rommet skal være som beskrevet i møte 1. Dør fra korridor bør slå mot vask. Høyskap flyttes ned til der rørpost stod. Plassering av formalinmaskin (lukket for dosering) ved avtrekksbenk. Kjemikaliskap for lagring av lukket beholder for formalin kan stå som skissert. Trenger ikke ventilering.</p> <p>Gruppen angir plassering av PCer og datapunkt</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Anita Sofie Fenne frist: 08 des 2023</b><br/> <b>Laboratorium, preparatrom</b><br/> <u>Gruppen angir plassering av PCer og datapunkt</u><br/> 08 des 2023<br/> <i>Det er behov for tre IKT-punkt; ved avtrekksskap, ved formalindoseringsmaskinen og ved pc-plass. Se skisse side 6 i vedlagte Powerpoint. (Anita Sofie Fenne)</i></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Flyt i rommet</b><br/> <u>Rørpost flyttes ut av rommet med tilgang fra korridor, og flyten i rommet skal være som beskrevet i møte 1. Dør fra korridor bør slå mot vask. Høyskap flyttes ned til der rørpost stod. Plassering av formalinmaskin (lukket for dosering) ved avtrekksbenk. Kjemikaliskap for lagring av lukket beholder for formalin kan stå som skissert. Trenger ikke ventilering.</u></p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>013</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>08.01.191/192 Renhold</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.191 og 08.01.192 Renhold, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p>Prosjekteringsgruppen bør spesifisere hvor lading/docking av skjermer til renholdsvogner skal gjøres. Det er ønskelig med flere vegghengte åpne hyller, dersom det er plass i rommet. Vask, utslagsvask og skovask kan plasseres sammen.</p> <p><u>08 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Ang. vask</b><br/> <u>Vask, utslagsvask og skovask kan plasseres sammen.</u></p> <p><u>08 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Ang. hyller</b><br/> <u>Det er ønskelig med flere vegghengte åpne hyller, dersom det er plass i rommet.</u></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Renholdsrom</b><br/> <u>Prosjekteringsgruppen bør spesifisere hvor lading/docking av skjermer til renholdsvogner skal gjøres i rommet.</u></p> |
| <p><b>014</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>SRF 087.25 Lager, væske</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.185 og 08.01.096 Lager, væske, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p>Varmeskapet bør være stort og plasseres nærmere døren. Døren må være bred nok for inntransport av AGV-vogn (gjelder SRF).</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Lager, væske</b><br/> <u>Varmeskapet bør være stort og plasseres nærmere døren. Døren må være bred nok for inntransport av AGV-vogn.</u></p>  |
| <p><b>015</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>Lager, sterilt</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.093 og 08.01.094 Lager, sterilt, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Møblering og utstyr</b><br/> <u>Gruppen ønsker at rommene møbleres med mobile kasse-bakke-skap isteden for reoler. Bestillingssystem for brikker (aktiv forsyning) plasseres i nærheten av dør. PC med strekkodeleser mangler.</u></p>  |
| <p><b>016</b></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>Lager, forbruksvarer</b></p> <p>Innspillene gjelder rom 08.01.188 og 08.01.189 Lager, forbruksvarer, da rommene skal være identiske i begge plan.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b><br/> <b>Lager, forbruksvarer</b><br/> <u>Bestillingssystem/stativ for brikker (aktiv forsyning) plasseres i nærheten av dør. PC med strekkodeleser mangler.</u></p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>017</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>Lager, leiringsutstyr 08.01.193</b></p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Rommet utforming</b></p> <p><u>Rommet er uhensiktsmessig utformet i forhold til utstyret som skal lagres på dette rommet. Døren må være stor nok til at utstyr kan transporteres inn og ut.</u></p>   |
| <p><b>018</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>Garderobe 08.01.154</b></p> <p>Ikke gjennomgått i møtet</p>  |
| <p><b>019</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>Møte, stort 08.01.186</b></p> <p>Ikke gjennomgått i møtet</p>  |
| <p><b>020</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>SRF 041.02 Forberedelse steril oppdekking</b></p> <p>Standardrommet er spesifisert med gjennomstikkskap, men forsyning kan foregå fra korridor i gjennomstikksnisje.</p> <p>Gjennomstikkskap mellom forberedelse steril oppdekking og operasjon er ikke behov for, fjernes på NRH.</p> <p>Alle skap kassebakke bør ha samme størrelse, skal være 60X40. ARK sjekker.</p> <p>1 bakbord, assistansebord og 1 trillebord. Bakbord, som er større 120 og 150. Pass på at bordene kan gå gjennom dørene.</p> <p><u>01 des 2023</u> <b>Marte Loen frist: 15 des 2023</b></p> <p><b>Forberedelse steril oppdekking</b></p> <p><u>Standardrommet er spesifisert med gjennomstikkskap, men forsyning kan foregå fra korridor i gjennomstikksnisje. Gjennomstikkskap mellom forberedelse steril oppdekking og operasjon er ikke behov for, og det fjernes fra rommene på NRH.</u></p> <p><u>Alle skap kassebakke bør ha samme størrelse. Dører skal være store nok til at alle mobile bord kan gå gjennom.</u></p> |
| <p><b>022</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>Veien videre</b></p> <p>HSØ-PO og Nye planlegger for et supplerende møte med representanter for medvirkningsgruppen ang. arbeidsflyt. 4. møte i medvirkningsgruppen forventes avholdt i uke 6 2024.</p>  |
| <p><b>023</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>   | <p><b>Evt.</b></p> <p>Ang. maler. Fra HSØ-PO sin side er det ønskelig at det på samme måte som på NSA, angis hvilke rom de ulike malene kan knyttes til.</p>   |
| <p>Deltagere (avhuket = tilstede)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ingrid Halvorsen HELSE SØR-ØST RHF</p> |  |

Marte Loen

Ralf Kristensen HELSE SØR-ØST RHF

Stine Johannessen HELSE SØR-ØST RHF

Anita Sofie Fenne

Elisabeth Sogstad Grannes HELSE SØR-ØST RHF

Ellinor Bilet HELSE SØR-ØST RHF

Kent Roger Bjørklund

Thomas Pryssing HELSE SØR-ØST RHF

Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)



Deltakere møte 3 H Operasjon NRH.xlsx (002 - Velkommen – presentasjon av deltagere i møte )

| Gruppe   | Tematikk  | NSA | NRH | Felles |
|----------|---|-----|-----|--------|
| Gruppe A | <a href="#">Døgnområder voksne somatikk</a>                                       | X   | X   |        |
| Gruppe B | <a href="#">Akuttfunksjoner inkl. Obspost</a>                                     | X   | X   |        |
| Gruppe C | <a href="#">Dialyse</a>   | X   |     |        |
| Gruppe D | <a href="#">Endoskopi</a>   | X   | X   |        |
| Gruppe E | <a href="#">Føde og barsel, fødeobs., føde- og gynmottak og føde/gynpol.</a>      | X   | X   |        |
| Gruppe F | <a href="#">Intensiv, postoperativ og sammedagsmottak</a>                         | X   | X   |        |
| Gruppe G | <a href="#">Nyfødtintensiv</a>  | X   | X   |        |
| Gruppe H | <a href="#">Operasjon</a>   | X   | X   |        |
| Gruppe I | <a href="#">Bilddiagnostikk og intervensjon</a>                                   | X   | X   |        |
| Gruppe J | <a href="#">Laboratoriemedisin</a>  | X   |     |        |
| Gruppe K | <a href="#">Klinisk Service</a>   | X   |     |        |
| Gruppe L | <a href="#">Sengehåndtering (inkl. sengevask og -logistikk)</a>                   | X   |     |        |
| Gruppe M | <a href="#">Kantine og kjøkken</a>  | X   |     |        |
| Gruppe N | <a href="#">Vestibyle, fellesområder og Drifts- og vaktsentral</a>                | X   |     |        |
| Gruppe O | <a href="#">Sterilsentral og sentral enhet for endoskopvask</a>                   |     |     | X      |
| Gruppe P | <a href="#">Medisinsk teknologisk avdeling</a>                                    | X   | X   |        |
| Gruppe Q | <a href="#">Forskning og undervisning OUS/UiO</a>                                 | X   | X   |        |
| Gruppe R | <a href="#">Sykehusapotek og legemiddelhåndtering (inkl. sykehusapotekutsalg)</a> | X   | X   |        |
| Gruppe S | <a href="#">Høysikkerhetsisolater og infeksjonsmedisinsk døgnområde</a>           | X   |     |        |
| Gruppe T | <a href="#">Vare- og distribusjonssentral</a>                                     | X   |     |        |
| Gruppe U | <a href="#">PCI/Pacemakerarealer NSA</a>  | X   |     |        |





































## Gruppe Q - Forskning og undervisning OUS/UiO

| Klinikk          | Navn                             | Yrkesbakgrunn         | Rolle                      | E-post  | Møtt møte 1 | Møterom | Møtt møte 2 | Møterom | Møtt møte 3 | Møterom | Kommentar |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| MED              | <b>Vibeke Bratseth</b>           | <b>Forsker</b>        | <b>Gruppeleder NSA OUS</b> |   |             |         |             |         |             |         |           |
| MED              | Elisabeth Qvigstad               | Lege                  | Fagperson NSA              | <a href="mailto:eqwigsta@ous-hf.no">eqwigsta@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| NVR              | John-Anker Zwart                 | Forskningsleder       | Fagperson NSA              | <a href="mailto:j.a.h.zwart@medisin.uio.no">j.a.h.zwart@medisin.uio.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KLM              | Tone Tønjum                      | Lege                  | Fagperson NSA              | <a href="mailto:tone.tonjum@medisin.uio.no">tone.tonjum@medisin.uio.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| PHA              | Maria Løvhaug                    | Sykepleier            | Fagperson NSA              | <a href="mailto:uxlvhm@ous-hf.no">uxlvhm@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KIT              | Eystein Boye Jenssen             | Forskningssykepleier  | Fagperson NSA              | <a href="mailto:eysjen@ous-hf.no">eysjen@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| OPK              | Tone Tufte Bere                  | Forsker/Fysioterapeut | Fagperson NSA              | <a href="mailto:bereto@ous-hf.no">bereto@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KRN              | Knut Håkon Hole                  | Radiolog/forsker      | Fagperson NSA              | <a href="mailto:KHH@ous-hf.no">KHH@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KVI              | Anne Cathrine Staff              | Forkningsleder KVI    | Fagperson NSA              | <a href="mailto:UXNNAF@ous-hf.no">UXNNAF@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| TIK              | Henriette Fossum                 | IT-støtte             | Fagperson NSA              | <a href="mailto:henrif@ous-hf.no">henrif@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| EIE              | Kine Halvorsen Hjelkerud         | Leder                 | Fagperson NSA/NRH          | <a href="mailto:kinhje@ous-hf.no">kinhje@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| AKU              | Theresa M. Olasveengen           | Lege                  | Fagperson NSA/NRH          | <a href="mailto:uxothe@ous-hf.no">uxothe@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| HLK              | <b>Håvard Attramadal</b>         | <b>Lege</b>           | <b>Gruppeleder NRH</b>     | <a href="mailto:havarda@ous-hf.no">havarda@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| TIK              | Mona Elisabeth Rootwelt-Revheim  | Lege                  | Fagperson NRH              | <a href="mailto:monar@ous-hf.no">monar@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KRE              | Pål Andre Holme                  | Lege                  | Fagperson NRH              | <a href="mailto:pholme@ous-hf.no">pholme@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| NVR              | <b>Tone Hakvåg Rønning (ut?)</b> | Sykepleier            | Fagperson NRH              | <a href="mailto:roeton@ous-hf.no">roeton@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KIT              | Sverre Holm                      | Forsker               | Fagperson NRH              | <a href="mailto:svehol@ous-hf.no">svehol@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| BAR              | Håvard Skjerven                  | Lege                  | Fagperson NRH              | <a href="mailto:UXSKJH@ous-hf.no">UXSKJH@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KLM              | Hasse K Zaré                     | Lege                  | Fagperson NRH              | <a href="mailto:haskhi@ous-hf.no">haskhi@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| KVI              | Ingvil Krarup Sørbye             | Lege                  | Fagperson NRH              | <a href="mailto:isorbye@ous-hf.no">isorbye@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| EIE              | Kine Halvorsen Hjelkerud         | Leder                 | Fagperson NRH/NSA          | <a href="mailto:kinhje@ous-hf.no">kinhje@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| AKU              | Theresa M. Olasveengen           | Lege                  | Fagperson NRH/NSA          | <a href="mailto:uxothe@ous-hf.no">uxothe@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| UiO Klinmed      | Knut Lundin                      | Professor             | Representant UiO/NSA       | <a href="mailto:knut.lundin@medisin.uio.no">knut.lundin@medisin.uio.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| UiO Klinmed      | Shuo-Wang Qiao                   | Professor             | Representant UiO/NRH       | <a href="mailto:s.w.qiao@medisin.uio.no">s.w.qiao@medisin.uio.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| VO               | Anette Farstad Therkildsen       | Bioingeniør           | Verneombud                 | <a href="mailto:anette.farstad.therkildsen@gmail.com">anette.farstad.therkildsen@gmail.com</a> <a href="mailto:anefar@ous-hf.no">anefar@ous-hf.no</a> |             |         |             |         |             |         |           |
| VO               | Per-Andreas Norseng              | Overingeniør          | Verneombud                 | <a href="mailto:perano@uio.no">perano@uio.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| FAGF             | Ellinor Lønnå                    | Sykepleier            | Tillitsvalgt               | <a href="mailto:elloen@ous-hf.no">elloen@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| NSF              | Vegard Andreas Jacobsen          | Lungesykepleier       | Tillitsvalgt               | <a href="mailto:velarr@ous-hf.no">velarr@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| Forskerforbundet | Benedicte Stavik                 | Seniorforsker         | Tillitsvalgt               | <a href="mailto:benedicte.stavik@ous-research.no">benedicte.stavik@ous-research.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| DNLF             | Einar August Høgestøl            | Lege                  | Tillitsvalgt               | <a href="mailto:eiaand@ous-hf.no">eiaand@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| BRUKERREP        | Helene Wangberg                  |                       | Brukerrepresentant         | <a href="mailto:wangb@online.no">wangb@online.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| BRUKERREP        | Kari Grønås                      |                       | Brukerrepresentant         | <a href="mailto:kari.gronas@gmail.com">kari.gronas@gmail.com</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| NYE OUS          | Kent Roger Bjørklund             | Intensivsykepleier    | Fagkoordinator NSA         | <a href="mailto:kebjoe@ous-hf.no">kebjoe@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| NYE OUS          | Trine Ertzeid                    | Sykepleier            | Fagkoordinator NRH         | <a href="mailto:tertzeid@ous-hf.no">tertzeid@ous-hf.no</a>  |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO           | Ralf Kristensen                  |                       | Fasilitator NRH            |   |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO           | Ole Martin Semb                  |                       | Referent NRH               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO           | Tina Sønnichsen                  |                       | Fasilitator NSA            |   |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO           | Ralf Kristensen                  |                       | Referent NSA               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| PG               | Emilie L. Schjetlein             |                       | Arkitekt NSA               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| PG               | Steinar Thomassen                |                       | Arkitekt NSA               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| PG               | Mette Berg Maastad               |                       | Arkitekt NRH               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| PG               | Karina Lehm                      |                       | Arkitekt NRH               |   |             |         |             |         |             |         |           |
| RUT              | Niels Rein                       |                       | Utstyrsrådgiver NSA        |   |             |         |             |         |             |         |           |
| RUT              | Niels Rein                       |                       | Utstyrsrådgiver NRH        |   |             |         |             |         |             |         |           |

|         |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UiO     | <b>Jorun Ur</b>          | <b>Arealkoordinator Klinmed NSA</b>                  | <b>Gruppeleder UiO NSA</b>   | <a href="mailto:jorun.ur@medisin.uio.no">jorun.ur@medisin.uio.no</a>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | <b>Knut Lundin</b>       | <b>Utdanningsleder Klinmed</b>                       | <b>Gruppeleder UiO</b>   | <a href="mailto:knut.lundin@medisin.uio.no">knut.lundin@medisin.uio.no</a>               |  |  |  |  |  |  |  |
| EIE     | Kine Halvorsen Hjelkerud | Leder  | Fagperson UiO  | <a href="mailto:kinhje@ous-hf.no">kinhje@ous-hf.no</a>                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| NYE OUS | Kent Roger Bjørklund     | Intensivsykepleier                                   | Fagkoordinator   | <a href="mailto:kebjoe@ous-hf.no">kebjoe@ous-hf.no</a>                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| NYE OUS | Trine Ertzeid            | Sykepleier   | Fagkoordinator   | <a href="mailto:tertzeid@ous-hf.no">tertzeid@ous-hf.no</a>                               |  |  |  |  |  |  |  |
| HSØ PO  | Tina Sønnichsen          |  | Fasilitator NSA  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSØ PO  | Ralf Kristensen          |  | Referent NSA   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG      | Emilie L. Schjetlein     |  | Arkitekt NSA   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG      | Steinar Thomassen        |  | Arkitekt NSA   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUT     | Niels Rein               |  | Utstyrsrådgiver  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Tor Henry Wold           | IT-leder Klinmed                                     | IKT/AV   | <a href="mailto:t.h.wold@medisin.uio.no">t.h.wold@medisin.uio.no</a>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Venke Jenssen            | Modulkoordinator Klinmed                             | Undervisningsplanlegging   | <a href="mailto:venke.jenssen@medisin.uio.no">venke.jenssen@medisin.uio.no</a>           |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Elisabeth Qvigstad       | Førsteamanuensis Klinmed                             | Undervisning Klinmed og deltakelse i medvirkningsprosessen fra OUS-siden | <a href="mailto:elisabeth.qvigstad@medisin.uio.no">elisabeth.qvigstad@medisin.uio.no</a> |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Charlotte Windel Stang   | Seniorarkitekt Eiendomsavdelingen UiO                | Koordinering mot UiO sentralt  | <a href="mailto:c.w.stang@admin.uio.no">c.w.stang@admin.uio.no</a>                       |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Fredrik Müller           | Professor og avdelingsleder mikrobiologi             | Fagperson/underviser mikrobiologi  | <a href="mailto:fredrik.muller@medisin.uio.no">fredrik.muller@medisin.uio.no</a>         |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Mona Beyer               | Professor for forskningsleder radiologi              | Fagperson/underviser radiologi   | <a href="mailto:m.k.beyer@medisin.uio.no">m.k.beyer@medisin.uio.no</a>                   |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Knut Håkon Hole          | Undervisningsleder radiologi                         | Fagperson/underviser radiologi   | <a href="mailto:knuthhol@medisin.uio.no">knuthhol@medisin.uio.no</a>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Sara Clarke              | Seksjonssjef medisinsk bibliotek                     | Fagperson bibliotek  | <a href="mailto:sara.clarke@ub.uio.no">sara.clarke@ub.uio.no</a>                         |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Heidi Rustad             | Seksjonsleder Universitetsbiblioteket                | Fagperson bibliotek NSA  | <a href="mailto:b.h.rustad@ub.uio.no">b.h.rustad@ub.uio.no</a>                           |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Dan Atar                 | Forskningsleder MDK                                  | Arbeidsgruppe ULNA(møte 2) NSA   | <a href="mailto:dan.atar@medisin.uio.no">dan.atar@medisin.uio.no</a>                     |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Ida Gjervold Lunde       | Professor II MDK                                     | Arbeidsgruppe ULNA(møte 2) NSA   | <a href="mailto:i.g.lunde@medisin.uio.no">i.g.lunde@medisin.uio.no</a>                   |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Mette Sannes             | Enhetsleder OUS/MED                                  | Arbeidsgruppe ULNA(møte 2) NSA   | <a href="mailto:uxmesa@ous-hf.no">uxmesa@ous-hf.no</a>                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| HSØ PO  | Guro Urdahl              |  | Rådgiver VVS/NSA-UiO   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UiO     | Bente Vasbotten          | <b>Deltar i møte 2 - ser an deltakelse i runde 3</b> | Hovedverneombud UiO  | <a href="mailto:b.i.h.vasbotten@medisin.uio.no">b.i.h.vasbotten@medisin.uio.no</a>       |  |  |  |  |  |  |  |

**Gruppe R - Sykehusapoteket og legemiddelhåndtering (inkl. sykehusapotekutsalg)**

| Klinikk   | Navn                          | Yrkesbakgrunn                          | Rolle                  | E-post   | Kalles inn til møte 1 | Møtt møte 1 | Møterom | Kalles inn til møte 2 | Møtt møte 2 | Møterom | Møtt møte 3 | Møterom | Kommentar |
|-----------|-------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| APOTEK    | <b>Ingunn Olsen</b>           | <b>Prosjektleder</b>                   | <b>Gruppeleder NSA</b> | <a href="mailto:ingunn.olsen@sykehusapotekene.no">ingunn.olsen@sykehusapotekene.no</a>                                 | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Irene Sunnvoll                | Farmasøyt                              | Fagperson NSA          | <a href="mailto:irene.sunnvoll@sykehusapotekene.no">irene.sunnvoll@sykehusapotekene.no</a>                             | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| OSS       | Vetle Hallberg                | Portør                                 | Fagperson NSA          | <a href="mailto:vehall@ous-hf.no">vehall@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| DST       | Thale Marie Asp Strøm         | Lege                                   | Fagperson NSA          | <a href="mailto:b21562@ous-hf.no">b21562@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| PHA       | Elisabeth Aase Grytten        | Sykepleier                             | Fagperson NSA          | <a href="mailto:uxelyt@ous-hf.no">uxelyt@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| AKU       | Stina Ingrid Engstrøm Heimdal | Intensivsykepleier                     | Fagperson NSA          | <a href="mailto:sheimdah@ous-hf.no">sheimdah@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| KLM       | Laila Irene Bruun             | Farmasøyt                              | Fagperson NSA          | <a href="mailto:lbr@ous-hf.no">lbr@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| OPK       | Ingvild Omland Erichsen       | Sykepleier                             | Fagperson NSA          | <a href="mailto:UXERII@ous-hf.no">UXERII@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| KLM       | Anne Grønstad                 | Farmasøyt                              | Fagperson NSA          | <a href="mailto:agroen@ous-hf.no">agroen@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| TIK       | Henriette Fossum              | IT-støtte                              | Fagperson NSA          | <a href="mailto:henrif@ous-hf.no">henrif@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| EIE       | Kine Halvorsen Hjelkerud      | Leder                                  | Fagperson NSA          | <a href="mailto:kinhje@ous-hf.no">kinhje@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| AKU       | Lindis Meland-Tangen          | Anestesisykepleier                     | Fagperson NRH          | <a href="mailto:LINTAN@ous-hf.no">LINTAN@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| BAR       | Ann Cecilie Mørk              | Pediatrisk sykepleier                  | Fagperson NRH          | <a href="mailto:UXANMR@ous-hf.no">UXANMR@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| TIK       | Cecilie Graver                | IT-støtte                              | Fagperson NRH          | <a href="mailto:cegrav@ous-hf.no">cegrav@ous-hf.no</a>   |                       |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| KRE       | Katerina Nezvalova Henriksen  | Farmasøyt                              | Fagperson NRH          | <a href="mailto:Katerina.Nezvalova.Henriksen@sykehusapotekene.no">Katerina.Nezvalova.Henriksen@sykehusapotekene.no</a> |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Camilla D. Hende              | Farmasøyt - Produksjon                 | Fagperson SA           | <a href="mailto:cadhen@sykehusapotekene.no">cadhen@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Tone Rojahn                   | Avd.leder - Produksjon                 | Fagperson SA           | <a href="mailto:tonero@sykehusapotekene.no">tonero@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Espen Gleditsch               | Kvalitetsleder - Produksjon            | Fagperson SA           | <a href="mailto:espengl@sykehusapotekene.no">espengl@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Dag Fossum                    | Avd.leder - Steril produksjon          | Fagperson SA           | <a href="mailto:dagfo@sykehusapotekene.no">dagfo@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Christina H. Larsen Wold      | Prosjektleder - Publikum               | Fagperson SA           | <a href="mailto:christinala@sykehusapotekene.no">christinala@sykehusapotekene.no</a>                                   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Hanne Steen                   | Avd.leder - Farmasøytiske tjenester    | Fagperson SA           | <a href="mailto:Hanne.Steen@sykehusapotekene.no">Hanne.Steen@sykehusapotekene.no</a>                                   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Stine B. Tallaksen            | Avd.leder - Farmasøytiske tjenester    | Fagperson SA           | <a href="mailto:Stine.Bryn.Tallaksen@sykehusapotekene.no">Stine.Bryn.Tallaksen@sykehusapotekene.no</a>                 | x                     |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Harald Stener                 | Avd.leder - Sykehusleveranser          | Fagperson SA           | <a href="mailto:harald.stener@sykehusapotekene.no">harald.stener@sykehusapotekene.no</a>                               | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Anna Björkman                 | Avd.leder - Sykehusleveranser          | Fagperson SA           | <a href="mailto:annab5@sykehusapotekene.no">annab5@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Jenny Ngyuen                  | Avd.leder - Sykehusleveranser          | Fagperson SA           | <a href="mailto:jethng@sykehusapotekene.no">jethng@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Samira Benaissa               | Apotektekniker/teamleder               | Fagperson SA           | <a href="mailto:samirabe@sykehusapotekene.no">samirabe@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Ida K. Nilsen                 | Seniorrådgiver tekniske installasjoner | Fagperson SA           | <a href="mailto:jdknie@sykehusapotekene.no">jdknie@sykehusapotekene.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Kristoffer Kihle Olavesen     | Teknisk installasjon                   | Fagperson SA           | <a href="mailto:Kristoffer.Kihle.Olavesen@norconsult.com">Kristoffer.Kihle.Olavesen@norconsult.com</a>                 |                       |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| APOTEK    | Monica Gunnerød               | Prosjektleder Sykehusapotekene         | Fagperson SA           | <a href="mailto:monicagu@sykehusapotekene.no">monicagu@sykehusapotekene.no</a>   |                       |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| NSF       | Tom Ole Lindefjeld Hagen      | Operasjonssykepleier                   | Tillitsvalgt           | <a href="mailto:hagtom@ous-hf.no">hagtom@ous-hf.no</a>   |                       |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| BRUKERREP | Veslemøy Ruud                 |  | Brukerrepresentant     | <a href="mailto:veru_13@hotmail.com">veru_13@hotmail.com</a>   | x                     |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| BRUKERREP | Tove Nakken                   |  | Brukerrepresentant     | <a href="mailto:tove.nakken@online.no">tove.nakken@online.no</a>   | x                     |             |         |                       |             |         |             |         |           |
| NYE OUS   | Trine Braaten                 | Jordmor                                | Fagkoordinator NSA     | <a href="mailto:uxtrra@ous-hf.no">uxtrra@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| NYE OUS   | Anita Sofie Fenne             | Operasjonssykepleier                   | Fagkoordinator NRH     | <a href="mailto:afenne@ous-hf.no">afenne@ous-hf.no</a>   | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| HSØ PO    | Elisabeth Gudmundsen          |  | Fasilitator NSA        |  | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| HSØ PO    | Tina Sønnichsen               |  | Referent NSA           |  | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| PG        | Sigrid Rossebø Hansen         |  | Arkitekt NSA           |  | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| PG        | Silje Gohn                    |  | Arkitekt NSA           |  | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| RUT       | Charanjit Singh Jhutti        |  | Utstyrsrådgiver NSA    |  | x                     |             |         | x                     |             |         |             |         |           |
| HSØ PO    | Guro Urdahl                   |  | Rådgiver VVS/NSA       |  |                       |             |         | x                     |             |         |             |         |           |



**Gruppe T - Vare- og distribusjonsentral NSA**

| Klinikk              | Navn   | Yrkesbakgrunn                 | Rolle               | Mailadresse  | Møtt møte 1 | Møterom | Møtt møte 2 | Møterom | Møtt møte 3 | Møterom | Kommentar |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|--|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| DST                  | <b>Terje Gårdsmoen</b>                               | <b>Programleder logistikk</b> | <b>Gruppeleder</b>  | <a href="mailto:tergae@ous-hf.no">tergae@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| AKU                  | Fredrik Fällman                                      | Spesialsykepleier             | Fagperson NSA       | <a href="mailto:uxfrfa@ous-hf.no">uxfrfa@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| KLM                  | Christin Thrane Pedersen                             |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:chtped@ous-hf.no">chtped@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| MED                  | Berit Baklid Ege                                     |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:UXBEEG@ous-hf.no">UXBEEG@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| OSS                  | Rolf Amund Stark                                     |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:rolsta@ous-hf.no">rolsta@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| OSS                  | Harald Brekke  |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:UXHAKK@ous-hf.no">UXHAKK@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| OSS                  | Eivind Fjeld Marigård                                |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:UXMEIV@ous-hf.no">UXMEIV@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| OSS                  | Jatinderpal Singh                                    |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:JATSIN@ous-hf.no">JATSIN@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| OSS                  | NN - Prosjektleder Fysisk infrastruktur og transport |                               | Fagperson NSA       |  |             |         |             |         |             |         |           |
| PHA                  | Trond Tangnes  |                               | Fagperson NSA       | <a href="mailto:TROTAN@ous-hf.no">TROTAN@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| KHVO OSS             | Liv Inger Homleid                                    |                               | VO                  | <a href="mailto:lihomlei@ous-hf.no">lihomlei@ous-hf.no</a>                         |             |         |             |         |             |         |           |
| VO Transport Ullevål | Andre Lukkassen                                      |                               | VO                  | <a href="mailto:anlukk@ous-hf.no">anlukk@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| Fagforbundet         | Ingar Magne Allergodt                                |                               | TV                  | <a href="mailto:ingall@ous-hf.no">ingall@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| Nye OUS              | Terje Hellerud Kluften                               | Spesialsykepleier             | Fagkoordinator NSA  | <a href="mailto:uxtekl@ous-hf.no">uxtekl@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| Nye OUS              | Kent Roger Bjørklund                                 | Spesialsykepleier             | Fagkoordinator NSA  | <a href="mailto:kebjoe@ous-hf.no">kebjoe@ous-hf.no</a>                             |             |         |             |         |             |         |           |
| Nye OUS              | Trine Ertzeid  | Sykepleier                    | Fagkoordinator NRH  | <a href="mailto:tertzeid@ous-hf.no">tertzeid@ous-hf.no</a>                         |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO               | Tina Sønnichsen                                      |                               | Referent NSA        | <a href="mailto:Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no">Tina.Sonnichsen@sykehusbygg.no</a> |             |         |             |         |             |         |           |
| HSØ PO               | Espen Eilertsen                                      |                               | Fasilitator NSA     | <a href="mailto:Espen.Eilertsen@sykehusbygg.no">Espen.Eilertsen@sykehusbygg.no</a> |             |         |             |         |             |         |           |
| PG                   | Hans Guttormsgård                                    |                               | Arkitekt NSA        | <a href="mailto:hans.guttormsgaard@ratioark.no">hans.guttormsgaard@ratioark.no</a> |             |         |             |         |             |         |           |
| PG                   | Ermin Krupic   |                               | Arkitekt NSA        | <a href="mailto:erkru@arkitema.com">erkru@arkitema.com</a>                         |             |         |             |         |             |         |           |
| RIV                  | Guro Urdahl  |                               | Rådgiver            | <a href="mailto:Guro.Urdahl@multiconsult.no">Guro.Urdahl@multiconsult.no</a>       |             |         |             |         |             |         |           |
| RUT                  | Niels Rein   |                               | Utstyrsrådgiver NSA | <a href="mailto:niels.rein@metier.no">niels.rein@metier.no</a>                     |             |         |             |         |             |         |           |



08.01.004 Operasjon, hybrid

| Artikkel     | Artikkel-Navn                                  | Antall | Ansvar | Kommentar   |
|--------------|--|--------|--------|---|
| 013.127      | Aggregat varmeledd                             | 1      | RUT    |   |
| 012.037      | Anestesiapparat                                | 1      | RUT    |   |
| 031.021      | Anestesivogn                                   | 1      | RUT    |   |
| GPZ.004      | Arbeidstol, hovedartikkel                      | 3      | IARK   | Sadelkrakker hev/senk   |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk hev/senk            | 2      | RUT    | elektrisk hev/senk  |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                | 1      | HF     |   |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                           | 1      | RUT    |   |
| 012.021      | Diatermiapparat                                | 1      | RUT    |   |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                        | 6      | RUT    |   |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                          | 2      | RUT    |   |
| 012.031      | Infusjonsrack                                  | 2      | RUT    |   |
| 011.004.03   | Intervensjon, hybrid                           | 1      | RUT    |   |
| 039.015      | Kompressopsamler                               | 1      | RUT    | Fjernes. Erstattes med lite trillebord  |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                      | 3      | IARK   |   |
| 011.025      | Kontrastinjektor                               | 1      | RUT    |   |
| 061.003      | Modulbord                                      | 1      | RUT    |   |
| 014.016      | Navigasjonsutstyr                              | 1      | RUT    |   |
| 015.005.03   | Operasjonsbord, sokkel                         | 1      | RUT    |   |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør   | 1      | RUT    |   |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                | 2      | RUT    |   |
| 039.012      | Opptinn  | 1      | RUT    | 4 stk   |
|              |  |        |        | Se innmeldt pc-løsning for implantatstue  |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning               | 1      | IKT    |   |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert           | 1      | RUT    |   |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                         | 2      | IKT    | Se implantatstue  |
| 031.027      | Prosedrevogn                                   | 1      | RUT    | 2 stk   |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett              | 2      | RIV    |   |
| 062.015      | Sekkestativ                                    | 1      | RUT    | 2 stk   |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803      | 3      | IARK   | 4 stk   |
| 090.039      | Skjerm, operasjon, stor                        | 1      | IKT    |   |
| 090.005.04   | Skjerm, PC, medisinsk godkjent                 | 2      | IKT    |   |
| 090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55"               | 1      | IKT    |   |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"               | 1      | IKT    | 2 stk med frakker i M, L og XL og halskrager  |
| 037.003.01   | Stativ for blyfrakker, mobilt                  | 1      | RUT    | Fjernes.  |
| 039.017.02   | Stativ oppheng urinposer                       | 1      | RUT    |   |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                 | 2      | ARK    |   |
| 090.029      | Strekkodeleser                                 | 1      | IKT    |   |
| 016.014.01   | Sug, ejetor                                    | 1      | RUT    |   |
| 073.003      | Tralle, PC, hev-senk                           | 2      | IKT    | 3 stk små, 1 stk 150 cm bakkbord elektrisk hev/senk, 1 stk 120 cm bakkbord elektrisk hev/senk. Alt i rustfritt stål |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                     | 2      | RUT    |   |
| 015.001.01   | Uttakssentral, anestesi                        | 1      | RUT    |   |
| 015.001.02   | Uttakssentral, kirurgi                         | 2      | RUT    |   |
| 042.001.02   | Varmeskap, gulvmodell, 60liter                 | 1      | RUT    |   |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite | 1      | ARK    |   |
| 039.016      | Vekt for kompresser                            | 1      | RUT    | Fjernes. Behov for nærhet til blodgass  |

Innspill fra NOM (MOLS) Antallet er for hver stue, så antallet må ganges opp med antall stuer i Malen

| Antallet er for hver stue, så antallet må ganges opp med antall stuer i Malen | Mal A per stue         | Mal B per stue   | Mal C per stue |   |
|---|------------------------|------------------|----------------|---|
| Anestesi apparat  | 1                      |                  |                | For enklere endre hvilken side det opereres fra |
| ACT måler (anestesi)  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Argon Diatermi  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Batteri sag stor/liten  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Elektrisk drill m/skyll   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Bildestrying  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Blodvasker (cellsaver)  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Blærescanner  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Diatermi  | 1                      | 1                | 1              | 1 Argon stue C                                  |
| Doppler liten   | 1 Ukjent               |                  | Ukjent         |   |
| Doppler stor  | 1 Ukjent               |                  | Ukjent         |   |
| Hjertelungemaskin (og HCU)  | 1                      |                  |                |   |
| Hodeklave, enkel  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Hodeklave, gjennomlysbar  | 1                      | 0                | 0              |   |
| ICP(intracranial trykkmåler)  | 1                      | 0                | 0              |   |
| Laryngoskop video   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Laryngoskop   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Mikroskop   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Navigasjon IR   | 1                      |                  | 1              |   |
| Pasient varmer/kjøler (Varmeteppe)  | 1                      | 1                | 1              |   |
| Sug elektrisk   | 2                      | 2                | 2              |   |
| Ultralud til intrakraniell bruk   | 1                      | 0                | 0              |   |
| Ultraludspirator (Ex Cusa)  | 1                      | 1                | 0              |   |
| Gjennomlysbar operasjonsbordtopp med innfesting for hodeklave                 | 1                      | 1                | 1              | Antall vil kunne bestemmes av fag og virksomhet |
| Videodokumentasjon system   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Misonix   |                        | 1                | 1              |   |
| Nevrofysiologtstyr til målinger   |                        | 1                | 1              |   |
| Mageleiebord  |                        |                  | 1              |   |
| Robot (Rygg og traumatologi)  |                        |                  | 1              |   |
| Hololense (AR brille)   | 3                      | 3                | 3              |   |
| Vevsdiagnostikk (Spektroskopisk)  | 1                      |                  |                |   |
| Utstyr for filming av peroprativ US   |                        |                  |                | Tunell-CT med integrert navigasjonssystem       |
| Bildemodalitet  | CT angio (standardrom) | Robotisert angio |                |   |
| Trillbar stråleskjerm/blyvegg   | 1                      | 1                | 1              |   |
| Blyskjerm på arm, takhengt  | 2                      | 2                | 2              |   |



| Spørsmål   | Ansvar  | Avklaring   |
|--|---------|---|
| Det er ønskelig at det kvalitetssikres antall arbeidsplasser med PC per operasjonsstue (mobile arbeidsstasjoner, faste arbeidsstasjoner, anesthesiapparat inkl arbeidsstasjon)           | RUT     | 1 mobil for op.spl., 1 pc på anesthesiapparat, 1 pc for anestesilege i anestesisonen, og en pc for kirurger i nærhet til operasjonssonen, men nær dør.  |
| Det er programmert 2 stk operasjonslamper med monitorarm per operasjonsstue. Hvilken størrelse er ønsket på takhengte skjermer? Vil det være noen operasjonsstuer som avviker fra dette? | RUT     | 2 stk 32 tommer skjermer, bortsett fra på endoskopistue der de ønsket dobbelt skjerm på en av armene.   |
| Skal det være kamera i operasjonslampen?   | RUT     | Ja  |
| Det er ønsket ett punktavsug per operasjonsstue, hvor er dette mest hensiktsmessig plassert?   | RUT/RIV | Punktavsuget bør plasseres i fotenden av operasjonsbordet, på en fleksibel arm slik at den kan dekke i hovedsak hele pasienten, men uten at denne kommer i konflikt med operasjonslampene.<br>På endoskopistuen skal endoskopiutstyret være plassert i søyle. I tillegg vil det være mobile endoskopirack-systemer for andre fagområder og når det oppstår behov på andre stuer. Det programmeres kun det endoskopiracket som skal være i søylen på denne stua. |
| Skal endoskopirack kunne flyttes mellom rom?   | RUT     |   |

#### Generelle innspill fra Medvirkningsgruppen

2 hjertestartere pr etg

Ultralyd app lagt inn på implantat stuen, bør også ligge i anst forbredelsesrom = 6 pr etg

Behov for alarmsystem/varslingsknapp for akutte situasjoner, i anestesisonen

AV-routing på alle stuer

Styringsstystem for lamper, lysregulering og solavskjerming/mørklegging på et panel

Signalanlegg/varsling ved gjennomlysning/pågående bruk av laser/smitte/pågående kirurgi med styring fra stua

Vindu i alle dører bortsett fra WC, garderobe, MTU/teknisk nisje. Mulig for foliering.

Alle utstyslager og leiringslager har behov for tofløyete slagdører. Dette gjelder også operasjonsstuer og oppdekkingsrom.

Automatisk døråpner fot/hånd på oppdekkingsrom, operasjonsstuer, lagere, desinfeksjonsrom, preparatrom og anesthesi

forberedelsesrom. Berøringsfri døråpner i alle rom. Styring av åpningstid i operasjonsrom og oppdekkingsrom slik at åpningstiden

kan begrenses når det er nødvending.

Alle mobile skap skal ha gjennomgående samme størrelse for fleksibel bruk.

Kirurgisk håndvask plan 04: 08.01.052 er plassert for langt unna operasjonsstuene. Forslag - legges i nærhet til akuttheis "for føde" i plan 4.

Elektrisk hev/senk på alle assistansebord og bakbord 150 cm. Hydrauliske bord er ergonomisk lite egnet

Kirurgisk håndvask plan 03: Det er kun en kirurgisk håndvask i sonen med 4 stk 10 cfu-stuer. Det er behov for en kirurgisk håndvask til i dette området (2 vasker pr 2 stuer).

2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med hev/senk-funksjon pr operasjonsstue i begge plan (i kirurgisk sone).

Videodokumentasjonssystem på alle stuer



| SRMAL.106.08 Endoskopi                                  |  |                             |   |                            |
|---|--|-----------------------------|---|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen   | Tilbakemelding fra Nye OUS |
| 1   | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer? | RUT                         |   |                            |
| 2   |  |                             | Arteroskopi rack  |                            |
| 3   |  |                             | Laparoskopi rack  |                            |
| 4   |  |                             |   |                            |
| 5   |  |                             | 3 skjermer i feltet(gastro), str 32". Skjerm på utstyr fungerer som slaveskjerm |                            |

| Artikkelnr   | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr  |
|--------------|---|--------|--------|--|
| 013.127      | Aggregat varmepledd                                 |        | 1 RUT  |  |
| 012.037      | Anestesiapparat                                     |        | 1 RUT  |  |
| 031.021      | Anestesivogn  |        | 1 RUT  |  |
| GPZ.004      | Arbeidsstol, hovedartikkel                          |        | 3 IARK | 2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med hev/senk-funksjon pr operasjonsstue i begge plan (i kirurgisk sone).  |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk hev/senk                 |        | 1 RUT  | elektrisk hev/senk   |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                     |        | 1 HF   |  |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                                |        | 1 RUT  |  |
| 012.021      | Diatermiapparat                                     |        | 1 RUT  |  |
| 014.013      | Endoskopirack                                       |        | 1 RUT  | 2 parallell bruk av lapskopi og endoskopi.   |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                             |        | 6 RUT  |  |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                               |        | 2 RUT  |  |
| 012.031      | Infusjonsrack                                       |        | 1 RUT  |  |
| 039.015      | Kompressopsamler                                    |        | 1 RUT  | Fjernes. 2 stk små trillbare bord i rustfritt stål erstatter kompressfanger. Gjelder alle stuer.   |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                           |        | 2 IARK | 2 stk, vaskbart trekk  |
| 061.003      | Modulbord   |        | 1 RUT  |  |
| 015.005.01   | Operasjonsbord, mobilt, universalt                  |        | 1 RUT  |  |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør        |        | 1 RUT  |  |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                     |        | 2 RUT  | Kamera i en  |
| 039.012      | Opptrinn  |        | 1 RUT  | 4, inkl til student/hospitant  |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                    |        | 1 IKT  | 2 arbeidsplasser   |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert                |        | 1 RUT  |  |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                              |        | 2 IKT  | 1 på anesthesiapparatet, 1 på tralle til opr spl   |
| 031.027      | Prosedyre vogn                                      |        | 1 RUT  |  |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett                   |        | 2 RIV  | 1 søyle  |
| 062.015      | Sekkestativ   |        | 1 RUT  | 2 stk. Gjelder alle stuer.   |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803           |        | 4 IARK |  |
| 090.039      | Skjerm, operasjon, stor                             |        | 1 IKT  |  |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"                    |        | 1 IKT  |  |
| 039.017.02   | Stativ oppheng urinposer                            |        | 1 RUT  | Fjernes. Gjelder alle stuer.   |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                      |        | 2 ARK  | Gjelder alle stuer.  |
| 090.029      | Strekcodeleser                                      |        | 1 IKT  |  |
| 016.014.01   | Sug, ejetor   |        | 1 RUT  |  |
| 073.003      | Tralle, PC, hev-senk                                |        | 2 IKT  | 1 til opr spl  |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                          |        | 1 RUT  | 3 små og 1 stk bakbord elektrisk hev/senk bredde 150 cm (="bakbord) for instrumentoppdekking. Trillebord får funksjon som kompressfanger           |
| 015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer                   |        | 1 RUT  |  |
| 015.001.02   | Uttakssentral, kirurgi                              |        | 2 RUT  | Dimensjonert for vekten til lap skopi utstyr   |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord |        | 1 ARK  | 2  |
| 039.016      | Vekt for kompresser                                 |        | 1 RUT  | Fjernes  |
|              | Skinne på vegg for oppheng av leiringsutstyr        |        |        | Gjelder alle stuer.  |
|              | Kjøleskap m/fryser, ca 1.20 m høyde                 |        |        | Til transplantasjon. Bør plasseres utenfor operasjonsstua. Programmeres 1 kjøleskap for organer pr plan. Må være i arbeidshøyde pga hygiene og HMS |
|              | Varmeskap på hylle (lite)                           |        |        | HMS  |
|              | Bakbord, hev og senk bredde 150 cm                  |        | 1      | elektrisk hev/senk   |
|              | Trillebord, rustfritt til kompresser                |        | 2      |  |
|              | IV stativ m/hjul                                    |        | 1      |  |
|              | Overtrykksmansjetter                                |        | 2      | 2 stk 0,5 liter og 1 stk 1,0 liter   |
|              | Laryngoskop, video                                  |        | 1      | Barn div str   |
|              |   |        | 1      | Aspirator m/spesialprobe   |
|              |   |        |        | 2 stk Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter   |
|              |   |        |        | Shaver med skyllesystem  |
|              |   |        |        | Ultralyd med tilhørende endoskopiprobe (eks. gastro).  |

| SRMAL.106.02 Operasjon, robot                           |   |                             |   |                            |
|---|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |   | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen<br>Ikke gulvstående, men i<br>arbeidshøyde. Til varme iv<br>væsker og skyllevæsker.<br>2 kirurgske søyler på alle stuer | Tilbakemelding fra Nye OUS |
| 1   | Hva skal oppbevares i varmeskapet? Skal det plasseres på bord eller skal det være gulvstående ? | RUT                         |   |                            |
| 2   | Skal kirurgisøylen ha ett festepunkt, med 2 armer?  | RUT                         |   |                            |
| 3   | Kamera i en av lampene  |                             |   |                            |
| 4   | Skjerm til navigasjonssystem  |                             | Ja.   |                            |
| 5   |   |                             |   | AV-routing-system          |

| Artikkelnr   | Navn   | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr  |
|--------------|--|--------|--------|--|
| 013.127      | Aggregat varmepledd                                |        | 1 RUT  | 2  |
| 012.037      | Anestesiapparat                                    |        | 1 RUT  |  |
| 031.021      | Anestesivogn                                       |        | 1 RUT  |  |
| GPZ.004      | Arbeidsstol, hovedartikkel                         |        | 3 IARK | 2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med hevsenk-funksjon pr operasjonsstue i begge plan (i kirurgisk sone).   |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk hevsenk                 |        | 2 RUT  | 1 stk elektrisk hevsenk. Gjelder alle stuer.   |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                    |        | 1 HF   |  |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                               |        | 1 RUT  |  |
| 031.038.01   | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter         |        | 3 RUT  | 2 stk  |
| 012.021      | Diatermiapparat                                    |        | 1 RUT  |  |
| FSH.001      | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel                |        | 1 ARK  |  |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                            |        | 6 RUT  |  |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                              |        | 2 RUT  |  |
| 012.031      | Infusjonsrack                                      |        | 2 RUT  |  |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                          |        | 2 IARK | 1 stk Vaskbart trekk<br>2 stk. 1 standard modulbord/kommode for anestesi + 1 stk modulbod med skuffer, bredde 100 cm for robotutstyr   |
| 061.003      | Modulbord  |        | 1 RUT  |  |
| 014.019      | Monitorrack - operasjonsrobot endoskopi            |        | 1 RUT  |  |
| 015.005.03   | Operasjonsbord, sokkel                             |        | 1 RUT  | Operasjonsbord må tilpasses robot  |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør       |        | 1 RUT  |  |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                    |        | 2 RUT  | Samme som på implantatstue   |
| 014.021      | Operatørkonsoll - operasjonsrobot endoskopi        |        | 2 RUT  |  |
| 039.012      | Opptrekk   |        | 2 RUT  | 4 stk  |
| 016.047      | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter                 |        | 1 RUT  | Se implantatstue   |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                   |        | 3 IKT  | Se implantatstue   |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert               |        | 1 RUT  |  |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                             |        | 2 IKT  | Se implantatstue   |
| 031.027      | Prosedevogn  |        | 1 RUT  | Åpen, enkel vogn (skjelettvogn) til transportvogn  |
| 014.014      | Robot for endoskopiinngrep                         |        | 1 RUT  |  |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett                  |        | 1 RIV  | Motor og avsug må dekke antall enheter i bruk på stuen, kan være 4   |
| 062.015      | Sekkestativ  |        | 1 RUT  | 2 stk. Likt på alle operasjonsstuer  |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"                   |        | 1 IKT  |  |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                     |        | 2 ARK  |  |
| 090.029      | Strekkodeleser                                     |        | 1 IKT  |  |
| 016.014.01   | Sug, ejetor  |        | 2 RUT  |  |
| 073.003      | Tralle, PC, hevsenk                                |        | 2 IKT  | Lik løsning som beskrevet på implantatstue. Totalt 4 pc-plasser<br>3 små og 1 stk bakbord elektrisk hevsenk bredde 150 cm (=bakbord) for instrumentoppdekking. Trillebord får funksjon som kompressfanger                        |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                         |        | 2 RUT  |  |
| 015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer                  |        | 1 RUT  |  |
| 015.001.02   | Uttakssentral, kirurgi                             |        | 2 RUT  |  |
| 042.001      | Varmeskap  |        | 1 RUT  |  |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hevsenk med lite bord |        | 1 ARK  | Skinne på vegg for oppheng av leiringsutstyr<br>Kasse-bakke skap 4 stk likt på alle operasjonsstuer<br>IV stativ på hjul med mulighet for høydejustering<br>Laryngoskop alle str<br>Videolaryngoskop<br>Bronkoskop<br>Ultral lyd |

| SRMAL.106.05 Operasjon, sectio                          |   |                             |  |                            |
|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |   | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
| 1   | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (sectio)? |                             |  |                            |
| 2   |   |                             | AV-routing-system<br>Oppsamlingsug for 20 liter med automatisk rengjøring i dockingstasjon. Erstatte dagens oppsamlingsugesystem med kolber. |                            |
| 3   |   |                             | STAN forsterlydovervåkning   |                            |
| 4   |   |                             |  |                            |
| 5   |   |                             |  |                            |

| Artikkelnr   | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|--------------|---|--------|--------|---|
| 013.127      | Aggregat varmepledd                                 |        | 1 RUT  |   |
| 012.037      | Anestesiapparat                                     |        | 1 RUT  |   |
| 031.021      | Anestesivogn  |        | 1 RUT  |   |
| GPZ.004      | Arbeidsstol, hovedartikkel                          |        | 3 IARK | 2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med hev/senk-funksjon pr operasjonsstue i begge plan (i kirurgisk sone).   |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk hev/senk                 |        | 2 RUT  | 1 stk elektrisk hev/senk. Gjelder alle stuer  |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                     |        | 1 HF   |   |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                                |        | 1 RUT  | Samme som implantatstue   |
| 013.051      | Blærescanner  |        | 1 RUT  |   |
| 031.038.01   | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter          |        | 3 RUT  | Beholder 3 stk her  |
| 012.021      | Diatermiapparat                                     |        | 1 RUT  |   |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                             |        | 6 RUT  |   |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                               |        | 2 RUT  |   |
| 012.031      | Infusjonsrack                                       |        | 2 RUT  |   |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                           |        | 2 IARK | 1 stk Vaskbart trekk  |
| 061.003      | Modulbord   |        | 1 RUT  |   |
| 015.005.01   | Operasjonsbord, mobilt, universalt                  |        | 1 RUT  |   |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør        |        | 1 RUT  |   |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                     |        | 2 RUT  |   |
| 039.012      | Opptrinn  |        | 2 RUT  | 4 inkl. til student/hospitant   |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                    |        | 3 IKT  |   |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert                |        | 1 RUT  |   |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                              |        | 2 IKT  | Se tidligere svar.  |
| 031.027      | Prosedyre vogn                                      |        | 1 RUT  |   |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett                   |        | 2 RIV  |   |
| 062.015      | Sekkestativ   |        | 1 RUT  | 2 stk - gjelder alle stuer  |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803           |        | 4 IARK |   |
| 090.039      | Skjerm, operasjon, stor                             |        | 1 IKT  |   |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"                    |        | 1 IKT  |   |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                      |        | 2 ARK  |   |
| 090.029      | Strekkodeleser                                      |        | 1 IKT  |   |
| 016.014.01   | Sug, ejetor   |        | 2 RUT  |   |
| 073.003      | Tralle, PC, hev-senk                                |        | 2 IKT  |   |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                          |        | 1 RUT  | 3 små og 1 stk bakbord elektrisk hev/senk bredde 150 cm (= "bakbord) for instrumentoppdekking. Trillebord får funksjon som kompressfanger   |
| 015.001.01.2 | Uttaksentral, anesthesi, to armer                   |        | 1 RUT  |   |
| 015.001.02   | Uttaksentral, kirurgi                               |        | 2 RUT  |   |
| 042.001      | Varmeskap   |        | 2 RUT  |   |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord |        | 1 ARK  |   |
| 039.016      | Vekt for kompresser                                 |        | 1 RUT  | Beholdes her<br>IV stativ på hjul med mulighet for høydejustering<br>Skinne på vegg for oppheng av leiringsutstyr<br>Laryngoskop alle str<br>Videolaryngoskop<br>Bronkoskop<br>Ultralud |

| SRMAL.106.06 Operasjon urologi                          |                             |                                     |  |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS   |
| 1   |                             |                                     | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (urologi)? |
| 2   |                             |                                     |  |
| 3   |                             | AV-routing-system                   |  |
| 4   |                             | Oppsamlingsug 20 liter med          |  |
| 5   |                             | automatisk rengjøring i             |  |
|   |                             | dockingstasjon. Erstatte sluk i     |  |
|   |                             | gulv for urologi.                   |  |

| Artikkelnr   | Navn   | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|--------------|--|--------|--------|---|
| 013.127      | Aggregat varmepledd                                  |        | 1 RUT  |   |
| 012.037      | Anestesiapparat                                      |        | 1 RUT  |   |
| 031.021      | Anestesivogn   |        | 1 RUT  |   |
|              |  |        |        | 2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med  |
|              |  |        |        | hev/senk-funksjon pr operasjonsstue i   |
|              |  |        |        | begge plan (i kirurgisk sone).  |
| GPZ.004      | Arbeidsstol, hovedartikkel                           |        | 3 IARK |   |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk heve/senk                 |        | 2 RUT  |   |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                      |        | 1 HF   |   |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                                 |        | 1 RUT  |   |
| 031.038.01   | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter           |        | 3 RUT  | 2 stk rustfritt stål  |
| 012.021      | Diatermiapparat                                      |        | 1 RUT  |   |
| 014.013.01   | Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi                 |        | 1 RUT  |   |
| 011.005.02.1 | Gjennomlysning, mobil, C-bue                         |        | 1 RUT  |   |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                              |        | 6 RUT  |   |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                                |        | 2 RUT  |   |
| 012.031      | Infusjonsrack  |        | 2 RUT  |   |
| 039.015      | Kompressoppsamler                                    |        | 1 RUT  |   |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                            |        | 2 IARK | 1 stk Vaskbart trekk  |
| 012.027.01   | Laser, urologi                                       |        | 1 RUT  |   |
| 061.003      | Modulbord  |        | 1 RUT  |   |
| 015.005.01   | Operasjonsbord, mobilt, universalt                   |        | 1 RUT  |   |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør         |        | 1 RUT  |   |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                      |        | 2 RUT  |   |
| 039.012      | Opptrekk   |        | 2 RUT  | 4, inkl til student/hospitant   |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                     |        | 3 IKT  |   |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert                 |        | 1 RUT  |   |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                               |        | 2 IKT  |   |
| 031.027      | Prosedyrevogn  |        | 1 RUT  |   |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett                    |        | 2 RIV  |   |
| 062.015      | Sekkestativ  |        | 1 RUT  |   |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803            |        | 4 IARK |   |
| 090.039      | Skjerm, operasjon, stor                              |        | 1 IKT  |   |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"                     |        | 1 IKT  |   |
| 037.003.01   | Stativ for blyfrakker, mobilt                        |        | 1 RUT  | Stativ for oppheng av rtg frakker- helst i skap utenfor opr stue v/kirurgisk håndvask |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                       |        | 2 ARK  |   |
| 090.029      | Strekcodeleser                                       |        | 1 IKT  |   |
| 016.014.01   | Sug, ejektor   |        | 2 RUT  |   |
| 073.003      | Tralle, PC, heve-senk                                |        | 1 IKT  |   |
|              |  |        |        | 3 små og 1 stk bakbord elektrisk heve/senk  |
|              |  |        |        | bredde 150 cm (=bakbord) for  |
|              |  |        |        | instrumentoppdekking. Trillebord får  |
|              |  |        |        | funksjon som kompressfanger   |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                           |        | 2 RUT  |   |
| 015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer                    |        | 1 RUT  |   |
| 015.001.02   | Uttakssentral, kirurgi                               |        | 2 RUT  |   |
| 042.001      | Varmeskap  |        | 1 RUT  |   |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur heve/senk med lite bord |        | 1 ARK  |   |
| 039.016      | Vekt for kompresser                                  |        | 1 RUT  | Fjernes   |
|              |  |        |        | Skinne på vegg for oppheng av leiringsutstyr  |
|              |  |        |        | IV stativ på hjul med mulighet for høydejustering                                     |
|              |  |        |        | Laryngoskop alle str  |
|              |  |        |        | Videolaryngoskop  |
|              |  |        |        | Bronkoskop  |
|              |  |        |        | Ultralyd  |

| SRMAL.106.07 Operasjon implantat                        |  |                             |  |                            |
|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
| 1   | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (implantat)? | RUT                         |  |                            |
| 2   | 014.016  | Navigasjonsutstyr           | 1  | RUT                        |
| 3   |  |                             | Varmeskapet plasseres langsmed vegg på venstre side (mot korridor), nærmere døra i anestesisonen.  |                            |
| 4   |  |                             | Pc-plass for kirurg plasseres i kroken på høyre side nærmest dør evt. i motsatt hjørne på venstre side (langsmed vegg mot korridor). Anestesileges pc-plass er ved vinduet i anestesisonen. Trillbare skap vil være plassert nærmere den kirurgiske sonen. |                            |
| 5   |  |                             | Lampefeller til operasjon utenfor LAF-sonen<br>En av operasjonslampene med kamera i håndtaket (AV-løsning)<br>Oppsamlingssug for 20 liter med automatisk rengjøring i dockingstasjon. Erstatte dagens oppsamlingssugesystem med kolber.                    |                            |

| Artikkelnr   | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|--------------|---|--------|--------|---|
| 013.127      | Aggregat varmepledd                                 |        | 1 RUT  | 2 stk på disse stuene   |
| 012.037      | Anestesiapparat                                     |        | 1 RUT  |   |
| 031.021      | Anestesivogn  |        | 1 RUT  |   |
| GPZ.004      | Arbeidsstol, hovedartikkel                          |        | 3 IARK | 2 sadelkrakker (sitte-stå-krakk) med hev/senk-funksjon pr operasjonsstue i begge plan (i kirurgisk sone).<br>1 stk elektrisk hev/senk. Det andre er lagt inn på oppdekkingsrom  |
| 061.002      | Assistansebord, hydraulisk hev/senk                 |        | 2 RUT  |   |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                     |        | 1 HF   |   |
| 012.030      | Blod- og væskevarmer                                |        | 1 RUT  |   |
| 012.044      | Blodtomhetsapparat                                  |        | 1 RUT  |   |
| 037.004.01   | Blyskjerm, mobil                                    |        | 1 RUT  |   |
| 013.051      | Blærescanner  |        | 1 RUT  |   |
| 031.038.01   | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter          |        | 3 RUT  | 2 stk   |
| 012.021      | Diatermiapparat                                     |        | 1 RUT  |   |
| 011.005.02.1 | Gjennomlysning, mobil, C-bue                        |        | 1 RUT  | * erstattes med 1 stk G-bue på 1 av operasjonsstuene med denne malen  |
| 012.029.03   | Infusjonspumpe, sprøyte                             |        | 6 RUT  |   |
| 012.029.01   | Infusjonspumpe, volum                               |        | 2 RUT  |   |
| 012.031      | Infusjonsrack                                       |        | 2 RUT  |   |
| GPZ.005      | Kontorstol, hovedartikkel                           |        | 2 IARK | 1 stk Må ha vaskbart trekk (gjelder alle kontorstoler)  |
| 061.003      | Modulbord   |        | 1 RUT  |   |
| 015.005.01   | Operasjonsbord, mobilt, universalt                  |        | 1 RUT  |   |
| 015.007.02   | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør        |        | 1 RUT  |   |
| 015.002.07   | Operasjonslampe, med monitorarm                     |        | 2 RUT  | Ett av disse med kamera i lampehåndtak. To monitorer med 32" skjerm.  |
| 013.124      | Operasjonsmikroskop                                 |        | 1 RUT  | 1 stk på 4 operasjonstuer "implantat"   |
| 039.012      | Opptinn   |        | 2 RUT  | 4 stk   |
| 016.047      | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter                  |        | 1 RUT  | 1 stk 1 liter og 2 stk 0.5 liter (OP og ANE)  |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                    |        | 3 IKT  | 2 stk medisinsk godkjente pc'er (Op og ane.spl) + 2 pc-plasser (anestesilege og kirurgi)  |
| 017.001.03   | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert                |        | 1 RUT  | Anestesiapparat + telefon<br>Er Pc plass for anestesisykepleier og operasjonssykepleier. Totalt 4 pc-plasser i rommet inkl. på anestesiapparat  |
| 090.001.03   | PC, medisinsk godkjent                              |        | 2 IKT  | Transportvogn   |
| 031.027      | Prosedyrevogn                                       |        | 1 RUT  | Skjelettvogn i transportvogn  |
| 031.027.05   | Prosedyrevogn, sterilentral, åpen, enkel            |        | 2 RUT  |   |
| JWZ.006      | Røykavsug autostartboks, komplett                   |        | 2 RIV  |   |
| 062.015      | Sekkestativ   |        | 1 RUT  | 2 stk   |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803           |        | 4 IARK | Samme størrelse som på oppdekkingsrom   |
| 090.039      | Skjerm, operasjon, stor                             |        | 1 IKT  |   |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"                    |        | 1 IKT  |   |
| 037.003      | Stativ for blyfrakker                               |        | 1 RUT  |   |
| FXB.002      | Stativ, hansker, hovedartikkel                      |        | 2 ARK  |   |
| 090.029      | Strekcodeleser                                      |        | 1 IKT  |   |
| 016.014.01   | Sug, ejektor  |        | 2 RUT  |   |
| 073.003      | Tralle, PC, hev-senk                                |        | 2 IKT  | 2 små og 1 stk bakbord elektrisk hev/senk bredde 150 cm (= "bakbord) for instrumentoppdekking   |
| 061.001      | Trillebord, rustfritt stål                          |        | 2 RUT  |   |
| 015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer                   |        | 1 RUT  |   |
| 015.001.02   | Uttakssentral, kirurgi                              |        | 2 RUT  |   |
| 042.001      | Varmeskap   |        | 1 RUT  |   |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord |        | 1 ARK  |   |
| 039.016      | Vekt for kompresser                                 |        | 1 RUT  | Fjernes. Blodgass erstatter funksjonen. 1 stk vekt fins på preparatrom.   |
|              |   |        |        | Leiringsutstyrspakke sideleie, mageleie, mageleie m/klave<br>Carbontopper<br>Rtg frakker M, L, XL med 6 stk halskrager<br>Stativ for oppheng av rtg frakker- helst i skap utenfor opr stue v/kirurgisk håndvask<br>Skinne på vegg for oppheng av leiringsutstyr<br>Oppsamlingssug, flergangs<br>*G-bue på 1 stk operasjonsstue - erstatter 1 stk c-bue.<br>IV stativ på hjul med mulighet for høydejustering<br>Laryngoskop alle str<br>Videolaryngoskop<br>Bronkoskop<br>Ultralud<br>Cellsaver |

**08.01.187 Forberedelse, steril oppdekking**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   |                             | Dørbredde større enn 90 cm<br>for å kunne kjøre inn stort<br>bakkbord. Gjelder alle tre dører. |                            |
| 2   |                             | Ikke gjennomstikkskap til<br>operasjonsstue på NRH   |                            |
| 3   |                             | Glassfelt i alle dører slik at man<br>kan se inn når det er klart å<br>trille inn utstyr       |                            |
| 4   |                             | Dispenser til hånddesinfeksjon<br>på vegg nær døra   |                            |
| 5   |                             |  |                            |

| Artikkelnr | Navn                                      | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr                      |
|------------|---|--------|--------|--|
| GPZ.004    | Arbeidsstol, hovedartikkel                |        | 1 IARK |  |
| 061.002    | Assistansebord, hydraulisk hev/senk       |        | 2 RUT  | 2 stk elektrisk hev/senk                                       |
| GXZ.006    | Dispenser, sprit løst montert             |        | 1 ARK  |  |
| 091.002    | Pakke, PC bærbar kontorløsning            |        | 1 IKT  | Mobil pc-løsning   |
| 062.015    | Sekkestativ                               |        | 2 RUT  |  |
| GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 |        | 1 IARK | Samme str på alle trillbare skap i alle rom (standard løsning) |
| 090.029    | Strekcodeleser                            |        | 1 IKT  | 2 stk -skal kunne pakke opp til to operasjoner                 |
| 073.003    | Tralle, PC, hev-senk                      |        | 1 IKT  |  |
| 061.001    | Trillebord, rustfritt stål                |        | 2 RUT  | 1 stk bakkbord bredde 150, elektrisk hev/senk                  |

| 08.01.047 Desinfeksjon                                  |   |                             |   |   |
|---|---|-----------------------------|---|---|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |   | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen   | Tilbakemelding fra Nye OUS  |
| 1   | Rommet er programmeret med utstyr som ikke samsvarer med det programmerte arealet. Det bes om at dere kvalitetssikrer antall spyledekontaminatorer og instrumentvaskemaskiner, forslagsvis 2 + 1. | ARK                         | Større areal på uren side enn på ren side. Kan ta noe av arealet til Lager, rent Punktavsug, fleksibelt avtrekk på arm, på svingarm og hev/senk<br>nei<br>Klorheksidinsprit + andre desinfeksjonsmidler.<br>Vaskemidler til dekontaminator. Ikke behov for ventilasjon<br>1 stk tørkeskap for masker mm (anestesi)<br>Dette desinfeksjonrommet vil kun håndtere utstyr som skal være rent.<br>Tavle med skinner for oppheng av strekkodebrikker for bestilling av varer (Aktiv forsyning) |   |
| 2   | Avtrækshætte over kum tilfredsstillende det behovet for avtræk for behandling av utstyr?  | RIV                         |   |   |
| 3   | Skal der vaskes sko i dette rom?  | ARK                         |   |   |
| 4   | Hva skal oppbevares i kjemikalieskapet?   | RUT                         |   |   |
| Artikkelnr  | Navn  | Antall                      | Ansvar  | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
| FBC.003.01  | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri   |                             | 1 ARK   | Må avlastingsbenk ved siden av kum med plass til å legge fra seg robotutstyr med lengde ca 100 cm ved siden av kum. |
| FBA.045.01  | Arbeidsbenk rustfri d=620 b=900 h=900   |                             | 1 ARK   |   |
| 062.001.08  | Avfallsmodul for kildesortering   |                             | 1 HF  | 1 stk spyl med innsats for bøttevask.   |
| 054.052   | Dekontaminator, spyl  |                             | 3 RUT   |   |
| 054.057.01  | Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler  |                             | 1 RUT   |   |
| 016.050   | Docking til kirurgisk sug   |                             | 2 RUT   | Plassert i renholdsrom, tas ut her.   |
| MOC.001   | Gipsutskiller   |                             | 1 RIV   |   |
| FAC.011   | Kjemikalieskap - Hovedartikkel  |                             | 1 RIV   | 1 for luft og 1 for vann  |
| FSA.013.01  | Overskap, generell d=350 b=600 h=700  |                             | 4 ARK   |   |
| 059.004   | Rengjøringspistol for luft eller vanntilkobling   |                             | 1 RUT   |   |
| 062.015.02  | Sekkestativ, 4 hjul   |                             | 2 RUT   |   |
| NYZ.001   | Servant hovedartikkel - X   |                             | 1 RIV   |   |
| FXB.002   | Stativ, hansker, hovedartikkel  |                             | 1 ARK   |   |
| 016.014.03  | Sug, kirurgisk, for store volum - 20l, inkl. røykavsug  |                             | 2 RUT   |   |
| FSA.011.01  | Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600  |                             | 4 ARK   |   |

**08.01.191 Renhold**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen   | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1   |                             | 1 stk Vaskedesinfektor, stor med innsats for sko og bøtter                                  |                            |
| 2   |                             | 2 stk dokkingstasjon for væskeoppsamlingsug   |                            |
| 3   |                             | Tavle med skinner for oppheng av strekkodebrikker for bestilling av varer (Aktiv forsyning) |                            |
| 4   |                             |   |                            |
| 5   |                             |   |                            |

| Artikkelnr | Navn                                       | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr                             |
|------------|--|--------|--------|---|
| FBA.041.34 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=600   |        | 1 ARK  | Rustfritt stål  |
| GXZ.006    | Dispenser, sprit løst montert              |        | 1 ARK  |   |
| FHA.002.04 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=1200 |        | 1 ARK  | Hyller for oppbevaring på motsatt side av utslagsvask (vannsikkerhet) |
| GXZ.007    | Moppestativ, veggfast                      |        | 1 ARK  |   |
| FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700       |        | 1 ARK  |   |
| 038.014    | Renholdsvogn                               |        | 4 RUT  |   |
| UVZ.011    | Tappekran på vegg, vv                      |        | 1 RIV  | Må også være egnet for håndvask, hvis ikke bør håndvask legges inn.   |
| FSA.011.02 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900     |        | 1 ARK  |   |
| NYZ.010    | Utslagsvask Hovedartikkel - X              |        | 1 RIV  |   |
|            |  |        |        | Strekkodeavleser  |
|            |  |        |        | 2 stk Stativ for sko på hjul  |
|            |  |        |        | 1 stk kasse-skap, mobilt  |



| 08.01.183 Laboratorium, preparatrom                     |  |                             |   |  |
|---|--|-----------------------------|---|--|
| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen   | Tilbakemelding fra Nye OUS   |
| 1   | Dette rom er programmeret med utstyr som ikke samsvarer med det programmerede areal. I bedes kvalitetssikre behovet, da areal forøgelsen for dette utstysbehov betyr at andre funksjoner utgår/fortrænges. | ARK                         |   |  |
| 2   | Hvilken funksjonalitet skal formalinmaskinen ha? Skal det være et lukket system?   | RUT                         | Sikre rett formalin dosering i et lukket system   |  |
| 3   |  |                             | Rørpost med tilgang fra korridor  |  |
| 4   |  |                             | benk og pc for preparater til avhenting (ved vask)  |  |
| 5   |  |                             | Flytte høyskap på motsatt siden av benkeplate med kum                                       |  |
|   |  |                             | Hengsle om dør slik at døra slår mot høyre  |  |
|   |  |                             | Tavle med skinner for oppheng av strekkodebrikker for bestilling av varer (Aktiv forsyning) |  |
| Artikkelnr  | Navn   | Antall                      | Ansvar  | Kommentar til antall og/eller type utstyr  |
| FAC.006.02  | Avtreksbenk (avtrekk ned, bak), 1200mm   |                             | 1 RIV   |  |
| FBC.002.02  | Benkeplate med kum, d=620 b=1800   |                             | 1 ARK   |  |
| 016.048   | Dosatron, blander  |                             | 1 RUT   |  |
| 022.050   | Fikseringsinstrument med vakuum for vevsprøver   |                             | 1 RUT   |  |
| 032.005   | Formalindispenser  |                             | 1 RUT   |  |
| FSH.001   | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel  |                             | 1 ARK   |  |
| 041.009   | Ismaskin, knust is   |                             | 1 RUT   |  |
| FAC.011   | Kjemikalieskap - Hovedartikkel   |                             | 1 RIV   | Ikke behov for ventilasjon   |
| GFA.006.09  | Kjøle- og fryseskap, laboratorium,   |                             | 1 RUT   | Fjernes  |
| 022.018   | Laboratorievekt  |                             | 1 RUT   | Fjernes  |
| FSH.002.01  | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør   |                             | 4 ARK   |  |
| 091.008   | Pakke, PC – Vegghengt  |                             | 1 IKT   | 1 stk ved siden av vask og med tilknytning til benk for preparater klare til forsendelse |
| 091.007   | Pakke, PC standard kontorløsning   |                             | 1 IKT   | Fjernes. Men datapunkter til fikseringsinstrumentet                                      |
| 062.015   | Sekkestativ  |                             | 2 RUT   |  |
| 022.001   | Sentrifuge   |                             | 1 RUT   |  |
| NYZ.001   | Servant hovedartikkel - X  |                             | 1 RIV   |  |
| FTZ.001   | Speil veggfast, hovedartikkel  |                             | 1 ARK   | For evt. øyeskylling på flasker  |
| GPZ.001   | Stol hovedartikkel   |                             | 1 IARK  | Fjernes  |
| FSH.003.02  | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør  |                             | 4 ARK   |  |
| UZB.010   | Øyedusj vegghengt  |                             | 1 RIV   | Fjernes  |
| 039.016   | Vekt for kompresser  |                             | 2 RUT   | Kun 1 stk  |

**08.01.154 Garderobe, personal**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS   |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1   |                             |                                     | Fjerne dusj. Dusjing kan foregå i hovedgarderober. Benytte ledig areal til å utvide garderoben for omklodning. |
| 2   |                             |                                     |  |
| 3   |                             |                                     |  |
| 4   |                             |                                     |  |
| 5   |                             |                                     |  |

| Artikkelnr | Navn                                    | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|------------|---|--------|--------|---|
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering         |        | 1 HF   |   |
| FSA.021    | Garderobeskap d=550 b=400 hovedartikkel |        | 1 ARK  | Små, med valgbar kodelås som hotellsafer    |
| FXB.003    | Knagg, hovedartikkel                    |        | 1 ARK  | Knaggrekke for hvite frakker                |
| 062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul                     |        | 1 RUT  | 2 stk sekkestativ (hvitt og grønt tøy)      |
| NYZ.001    | Servant hovedartikkel - X               |        | 1 RIV  | Fjerne servant forutsatt servanter på WC    |
| FOZ.001.02 | Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430 |        | 1 ARK  |   |
| FTZ.001    | Speil veggfast, hovedartikkel           |        | 1 ARK  |   |
|            | Spritdispenser                          |        |        |   |
|            | Sko oppheng vegg                        |        |        | 10 par sko                                  |
|            |   |        |        | Hylle for operasjonshetter                  |
|            |   |        |        | Hyller for grønt tøy str S, M, L, XL og XXL |

**08.01.186 Møte, stort**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen<br>Hybelkjøkken, kjøleskap,<br>vanntilgang, kaffetrakter,<br>vannkoker | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   |                             |  |                            |
| 2   |                             |  |                            |
| 3   |                             |  |                            |
| 4   |                             |  |                            |
| 5   |                             |  |                            |

| Artikkelnr   | Navn                              | Antall | Ansvar  | Kommentar til antall og/eller type utstyr |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------|---|
| OMZ.017      | Auracast-sender, intern           |        | 1 RIKT  |   |
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering   |        | 1 HF    |   |
| 092.001.02   | AV-pakke, møterom/grupperom/skype |        | 1 RIKT  |   |
| GBA.005.01   | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700    |        | 2 IARK  |   |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning  |        | 1 IKT   | 3 stk                                     |
| OMZ.008      | SKAL_SLETTES_Teleslynge           |        | 1 IKT   |   |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65"  |        | 1 IKT   |   |
| GPZ.001.04   | Stol, besøk u/armlene, stablebar  |        | 5 IARK  |   |
| GPZ.001.01   | Stol, møte                        |        | 25 IARK |   |
| OAZ.009      | Tavlefangst-kamera                |        | 1 RIKT  |   |
|              |                                   |        |         | 3 stk kontorstoler                        |

**08.01.094 Lager, sterilt**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen                            | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   |                             | Berøringsfri automatisk<br>døråpner (fot/hånd)                 |                            |
| 2   |                             | Tavle med skinner for bestilling<br>av varer (aktiv forsyning) |                            |
| 3   |                             |  |                            |
| 4   |                             |  |                            |
| 5   |                             |  |                            |

| Artikkelnr | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr  |
|------------|---|--------|--------|--|
| GXZ.006    | Dispenser, sprit løst montert   |        | 1 ARK  |  |
| FSH.001    | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel                                   |        | 1 ARK  | Foring skrå topp b=450, Høyskap, kasse-<br>bakke d=650 b=457 h=2100 uten dør, så<br>mange som mulig. Flyttbart |
| 090.001    | PC  |        | 1 IKT  | Pakke, PC standard kontorløsning   |
| GHB.001.03 | Reol flyttbar, sterillager for container                              |        | 1 ARK  |  |
| GHB.001.02 | Reol flyttbar, sterillager kasse/bakke                                |        | 1 ARK  |  |
| FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord<br>Strekcodeleser |        | 1 ARK  |  |

**08.01.185 Lager, væske**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   |                             | Varmeskap plasseres ved døren med lett tilgang for de som henter væske til operasjonsstue. Må kunne passere med væskevogn/tralle |                            |
| 2   |                             | Tavle med skinner for bestilling av varer (aktiv forsyning)  |                            |
| 3   |                             | Berøringsfri automatisk døråpner (fot/hånd)  |                            |
| 4   |                             |  |                            |
| 5   |                             |  |                            |

| Artikkelnr   | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr                              |
|--------------|---|--------|--------|--|
| 062.001.08   | Avfallsmodul for kildesortering                     |        | 1 HF   | Fjerne avfallsmodul. Forpakning skal være fjernet før mottak operasjon |
| 091.007      | Pakke, PC standard kontorløsning                    |        | 1 IKT  |  |
| GSA.001.01   | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803           |        | 1 IARK | Fjerne skap. Gi plass til væskevogner/standardisert forsyning          |
| 090.029      | Strekcodeleser                                      |        | 1 IKT  |  |
| 042.001.02.2 | Varmeskap, gulvmodell, ca. 400 liter                |        | 1 RUT  |  |
| FBA.068.02   | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord |        | 1 ARK  | For bestilling   |

**08.01.188 Lager, forbruksvarer**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   |                             | Tavle med skinner for oppheng<br>av strekkodebrikker for<br>bestilling av varer (Aktiv<br>forsyning) |                            |
| 2   |                             |  |                            |
| 3   |                             |  |                            |
| 4   |                             |  |                            |
| 5   |                             |  |                            |

| Artikkelnr | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|------------|---|--------|--------|---|
| FBB.004.02 | Foring skrå topp b=450                            |        | 1 ARK  |   |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør |        | 5 ARK  | Flest mulig skap. Kasse-bakkeskap uten dør. |
| 090.005.01 | Skjerm, PC, standard                              |        | 1 IKT  |   |
| 061.001    | Trillebord, rustfritt stål<br>Strekkodeleser      |        | 1 RUT  |   |

**08.01.088 Lager, utstyr**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |   | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen  | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   | Hvilket utstyr bør programmeres i dette rommet? | RUT                         |  |                            |
| 2   |   |                             | Tofløyet slagdør   |                            |
| 3   |   |                             | Berøringsfri automatisk<br>døråpner for fot og hånd  |                            |
| 4   |   |                             | Rad med stikkontakter (20 stk)<br>langsmed vegg for lading av<br>MTU                                 |                            |
| 5   |   |                             | Tavle med skinner for oppheng<br>av strekkodebrikker for<br>bestilling av varer (Aktiv<br>forsyning) |                            |
|   |   |                             | Ultrafryser, minus 80 grader<br>(benbank)  |                            |

| Artikkelnr | Navn   | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr  |
|------------|--|--------|--------|--|
| FHA.002    | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel |        | 3 ARK  | To hyller i høyden, ha plass til trillbart MTU<br>under nederste hylle, eks. ultralydapparat |
| GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803              |        | 4 IARK | Kun 2 stk kasse-bakkeskap, mobilt  |
| KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom                                |        | 1 RIE  |  |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000                              |        | 1 RIE  |  |
|            | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord    |        | 1      |  |
|            | Strekkodeavleser                                       |        | 1      |  |
|            | Pakke, PC standard kontorløsning                       |        | 1      |  |
|            | El stikk m/USB   |        | ?      |  |
|            |  |        |        | 1 stk G-bue på utstyslager i plan 4  |
|            |  |        |        | 1 stk røntgenfrakkstativ på hvert utstyslager  |
|            |  |        |        | Røntgenfrakker og halskrager, skjørt og vest M, L og XL str                                  |
|            |  |        |        | 1 stk nervemonitoringsutstyr pr utstyslager  |
|            |  |        |        | 1 stk væskeoppsamlingssug til docking  |
|            |  |        |        | Blodtomhetsapparat med mansjett for barn og voksen   |
|            |  |        |        | Cell-saver 1 stk pr lager  |
|            |  |        |        | 1 stk argon diatermiapparat pr utstyslager   |

**08.01.193 Lager, leiringsutstyr**

| Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar<br>(RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra<br>medvirkningsgruppen          | Tilbakemelding fra Nye OUS |
|---|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1   | Hvilket utstyr skal programmeres i dette rommet? | RUT/ARK                     | Se liste nedenfor.                           |                            |
| 2   |  |                             | Tofløyet slagdør                             |                            |
| 3   |  |                             |  |                            |
| 4   |  |                             | Behov for plass til oppbevaring<br>av ekstra |                            |
| 5   |  |                             | operasjonsbord/bordtopper                    |                            |

| Artikkelnr | Navn  | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr   |
|------------|---|--------|--------|---|
|            | Veggskinne, utstyr l=1000                             |        | 2      | Til oppheng av leiringsutstyr   |
|            | Hylle vegghengt to i høyden på skinner, hovedartikkel |        | 2      | Hyller ønskes plassert langsmed venstre vegg, til leiringsmatriell; puter og ekstrautstyr til operasjonbord. Bør være plass til oppbevaring utstyr under hylle. |
|            | Pakke, PC standard kontorløsning                      |        | 1      |   |
|            | Strekkodeavleser                                      |        | 1      |   |
|            | Sykeromskanal, sengerom                               |        | 2      |   |
|            | El stikk m/USB  |        | ?      |   |
|            | IKT nettverk  |        | 1      |   |
|            | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord   |        | 1      |   |
|            |   |        |        | 2 stk galger for holding av ekstremiteter v/desinfeksjon av opr felt  |




# Operasjon NRH

- Innspill på plassering av støtterom for funksjoner



# Plan 3



Kun nødutgang mot PO/intensiv. Innslusing/omklodning for ansatte i garderobe i vest.

Væskelager og legemiddelnisje i vest i grønn sone, nærhet til de fire operasjonsstuene

Møterom og pauserom vegg i vegg, fortrinnsvis langs fasaden mot vest. Lys og utsikt. Kunne adskille møterom i flere rom. To dører inn til møterom. Møterom med hybelkjøkken.

Samle blått areal (FOU) i øst, og samle drift i vest. Tilgang til FOU fra grønn sone.

Mangler 1 stk stempel av kirurgisk håndvask i lamell J3, plan 3. Kun to vasker til fire stuer.

Drikkestasjoner i arbeidsstasjonene i lamell J3 og J4

Forberedelsesrom anestesi (Gr H). Plassere inn utstyr (inkl. pasientseng)

Alt personell sluses inn via garderobe. Fjerne dusj og utvide garderoben. Dusjing i hovedgarderobe

Flytte kommandosentral fra øst til vest, med nærhet til pauserom (tett på ledig personell)

P-plass sparkesykler (5 stk)

Lager plasseres først og fremst i mørke arealer, i rom uten vindu.

Benbank/ultrafryser i nærhet til rørpost – gjelder begge plan

# Plan 4

Samme stempel som i plan 3:

- Nødutgang mot intensiv. Innslusing via garderobe
- Rørpost i vest plassert som nå, men tilgang fra korridor, ikke i rom. Lik løsning i begge plan.
- Væskelager og legemiddelnisje i grønn sone med likt stempel som i plan 3 (vest i lamell J3)
- Møterom og pauserom vegg i vegg langs fasade mot vest
- Lager i mørke arealer
- Plassere inn anesthesiutstyr i forberedelsesrommene
- Drikkestasjon i lamell J3 og J4



- Flytte kommandosentral til vest og FOU-areal til øst (utenfor drift). Nærhet mellom kommandosentral og pauserom
- P-plass for 5 sparkesykler nært heis
- Ett stempel av kirurgisk håndvasker nærmere hybridstuene ved heisen (J3/J4) og hybridstuene lengt øst i J4. Kirurgisk håndvask for disse stuene ligger litt for avsides på denne skissen.
- MTU fra utstyrlager 08.01.087 flyttes lenger inn på grunn av lang avstand til virksomheten og manøvrering av utstyr gjennom flere dører.


Flytte lager hit. Flytte væskelager som beskrevet i plan 3.

# Plassering av BIP utstyr i operasjonsstue 60 kvm

Parallellforskyving av dører sterilt oppdekkingsrom til stuer for å unngå kollisjoner

Varmeskap på vegg mot korridor. Lett tilgang for både operasjon og anestesi. Ikke i konflikt med pasientseng som skal trilles inn

PC-plass for kirurg, enten langsmed vegg mot korridor eller langsmed vegg i kirurgisk sone (pacs-pc)

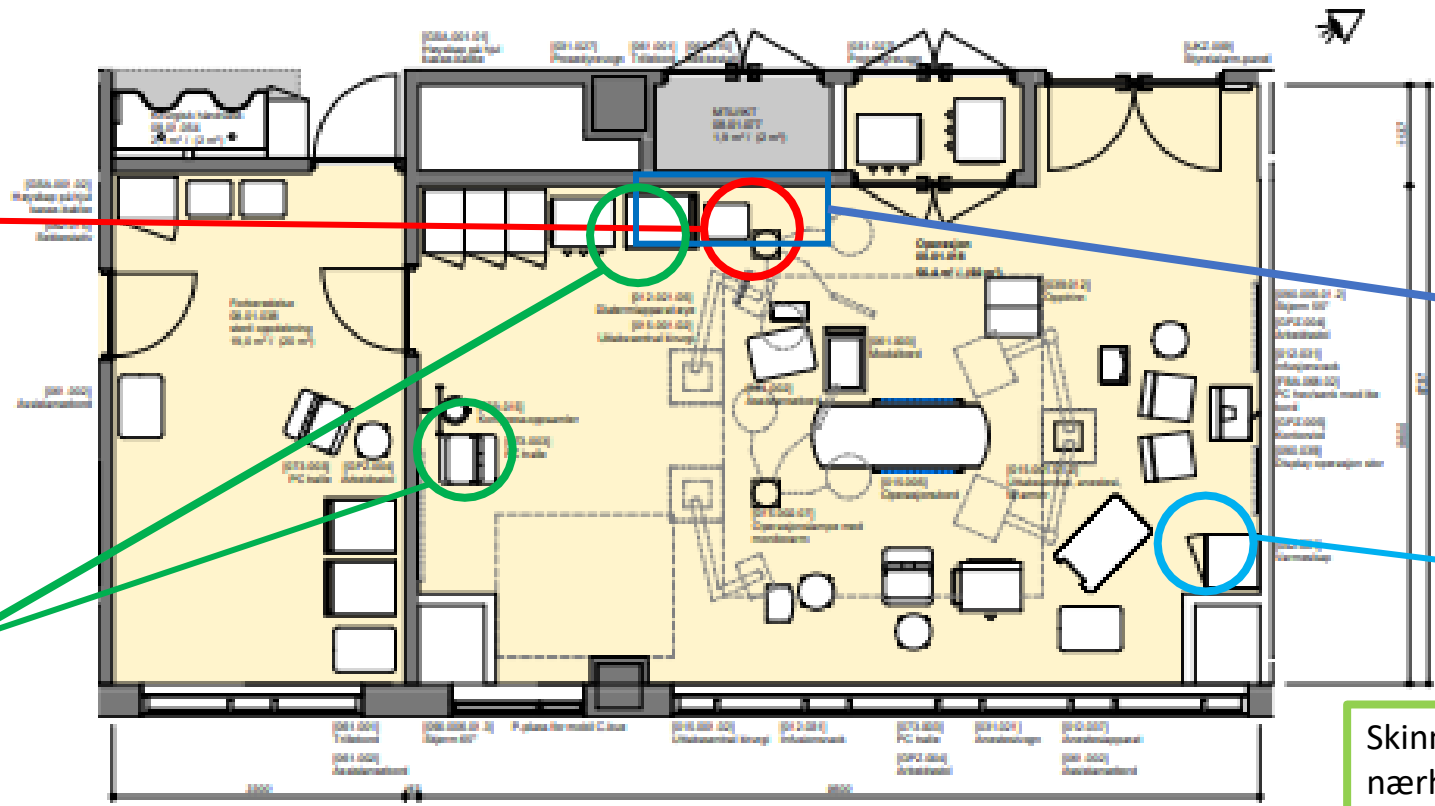

Gruppen ber om at skissene viser plasseringen av ventilasjonslukene

Stor PC-skjerm på vegg i siktlinjen til anestesi og koordinerende op.spl.

PC- plass anestesilege. I anesiesonen, gjerne ved vindu


Skinne for leiringsutstyr på vegg i nærhet til anestesi og koordinerende op.spl

# Plassering av BIP-utstyr i kluster av fire stuer



- Pc-plass for kirurg langsmed vegg mot korridor eller i kirurgisk sone (pacs-pc)
- Pc-plass for anestesilege i anestesisonen, nær vindu
- Varmeskap ved anestesi hjørne mot korridor eller langsmed veggen bak anesti, lett tilgjengelig for op.spl og anestesipl. Ikke i konflikt med seng/utstyr som skal trilles inn.
- Stor pc-skjerm i siktlinjen til koordinerende op.spl og anestesi, på vegg mot korridor.
- Stuene speiles.

# Preparatrom Operasjon



○ = IKT-punkter preparatrom

ARH/0000 - Byggherre Felles

### Møte 03 pulje 1 - H Operasjon - NRH

Møte 03 pulje 1 - H Operasjon - NRH

Sak ID:

49323

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Ralf Kristensen

Opprettet

30.10.2023 12:49:16

Category:

H - Operasjon

## Underlag og godkjenning

Completed by Thomas Pryssing, 2023-11-15 10:05

Materiale til Funksjonsmøte 3 klart for distribusjon til medvirkningsgruppen.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:53

PG laster opp underlag til møtet.

Completed By: Marte Loen 2023-11-14 21:48

Completed Comment: PG laster opp underlag til møtet.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:54

RUT laster opp underlag til møtet.

Completed By: Stine Louise Johannessen 2023-11-15 09:56

Completed Comment: RUT laster opp underlag til møtet.

Ralf Kristensen 2023-10-30 12:54

PO laster opp agenda til møtet.

Completed By: Thomas Pryssing 2023-11-15 09:22

Completed Comment: PO laster opp agenda til møtet.

Stine Louise Johannessen - 2023-11-15 09:56

Stine Louise Johannessen - 2023-11-15 09:56

Stine Louise Johannessen - 2023-11-15 09:42

Marte Loen - 2023-11-14 21:48

Thomas Pryssing - 2023-11-14 07:29

Ellinor Bilet - 2023-11-07 12:53

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:54

RUT laster opp underlag til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:54

PO laster opp agenda til møtet.

Ralf Kristensen - 2023-10-30 12:53

PG laster opp underlag til møtet.

ARH Tilbakemelding utstyr møte 3.pdf

F3 Gruppe H Operasjon til Omega.pdf

RFP operasjon (øvrige rom) NRH, møte 3.pdf

RFP operasjonsstuer NRH, møte 3.pdf

Operasjon NRH, spørsmål og utstyrsliste møte 3.xlsx

## Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Elise Emilsen Bakke, 2023-11-15 11:01

Saksunderlag er distribuert til deltakere fra OUS

## Steg 3 - Arbeidslogg

Delt med

Abbonenter:

Skrevet ut av Thomas Pryssing, 11.12.2023 08:12:39+01:00:00. (ID:arpt\_Workflow\_Item)

Filter: ID=49323

Agendapunkt: 001 - Agenda

9001 - Rådgiver utstyr  
8201 - Prosjektering NSA  
8202 - Prosjektering NRH  
0201 - Oslo universitetssykehus HF  
0000 - Byggherre Felles

Charanjit Singh Jhutti  
Ole Eskil Simonsen  
Anita Sofie Fenne  
Elise Emilsen Bakke  
Marte Loen  
Kent Roger Bjørklund  
Julia Gaczek  
Thomas Pryssing  
Ellinor Bilet